Ver.4.1

KYOCERA

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type 術式チャート

FINESIA® Surgical Guide System

Tapered type

術式チャートの見方

（例）サージカルガイドステント高さ9mm、インプラント径φ4.2 mm、骨内長8 mm、Tapered typeの場合

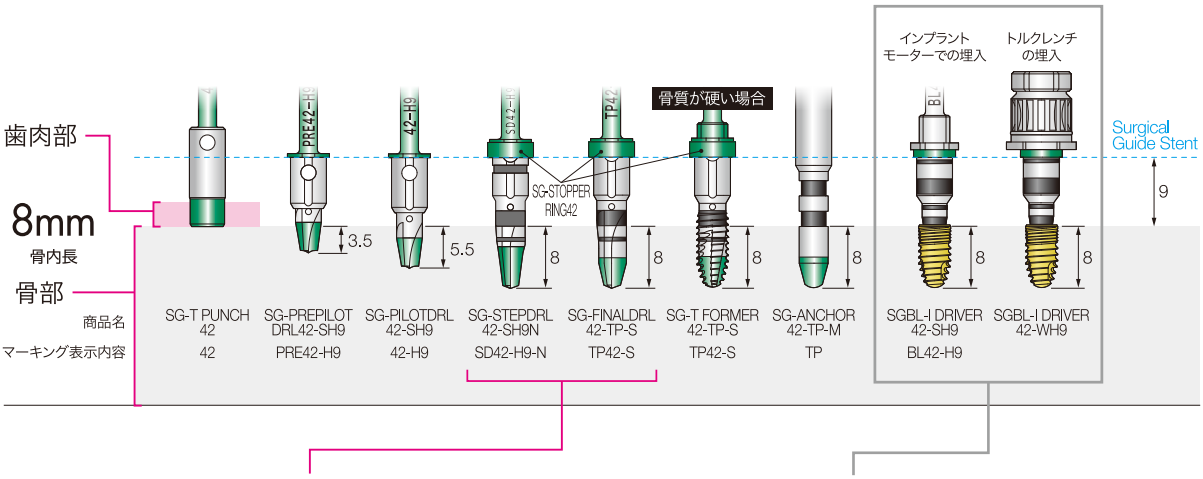

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPの
記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。

骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-SH＊タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-WH＊タイプを選択することができます
（ただし、インプラント径 Φ3.0mmには、どちらのドライバーも用意されていません）。

ドリル先端仕様

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPのドリルの刃長は、
インプラント体よりも下記のように長く設定されています。

SGステップドリル

φ4.2mm　φ4.7mm　φ5.2mm ➔0.2mm長い

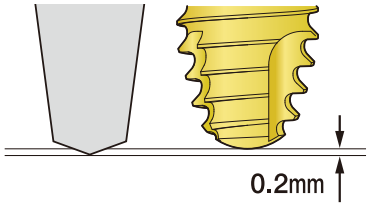

SGファイナルドリルTP

φ3.0mm　φ3.2mm　φ3.4mm　φ3.7mm ➔0.1mm長い

φ4.2mm　φ4.7mm　φ5.2mm ➔0.2mm長い

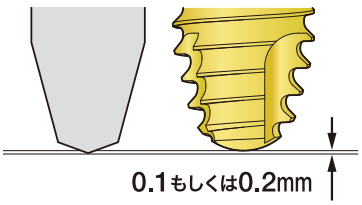

サージカルガイドステント高さ 9mm

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type 術式チャート

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.0mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

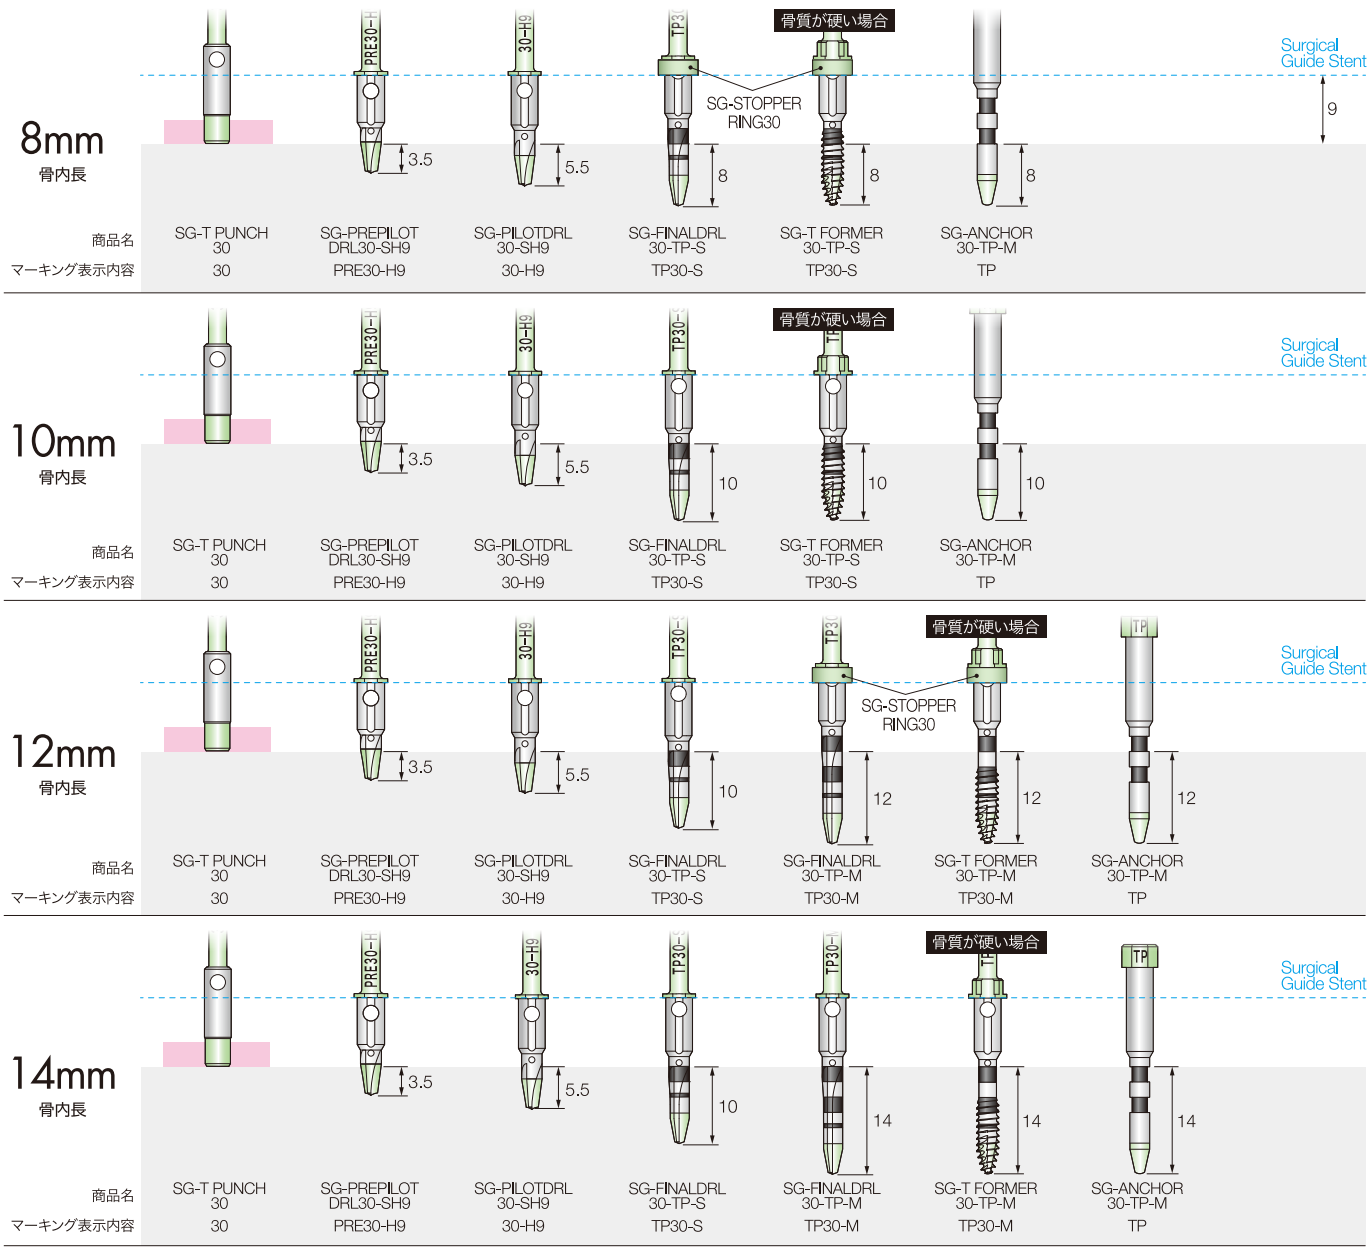

1P：1Piece

単位 :mm

9mm
サージカルガイドステント固定

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.2mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

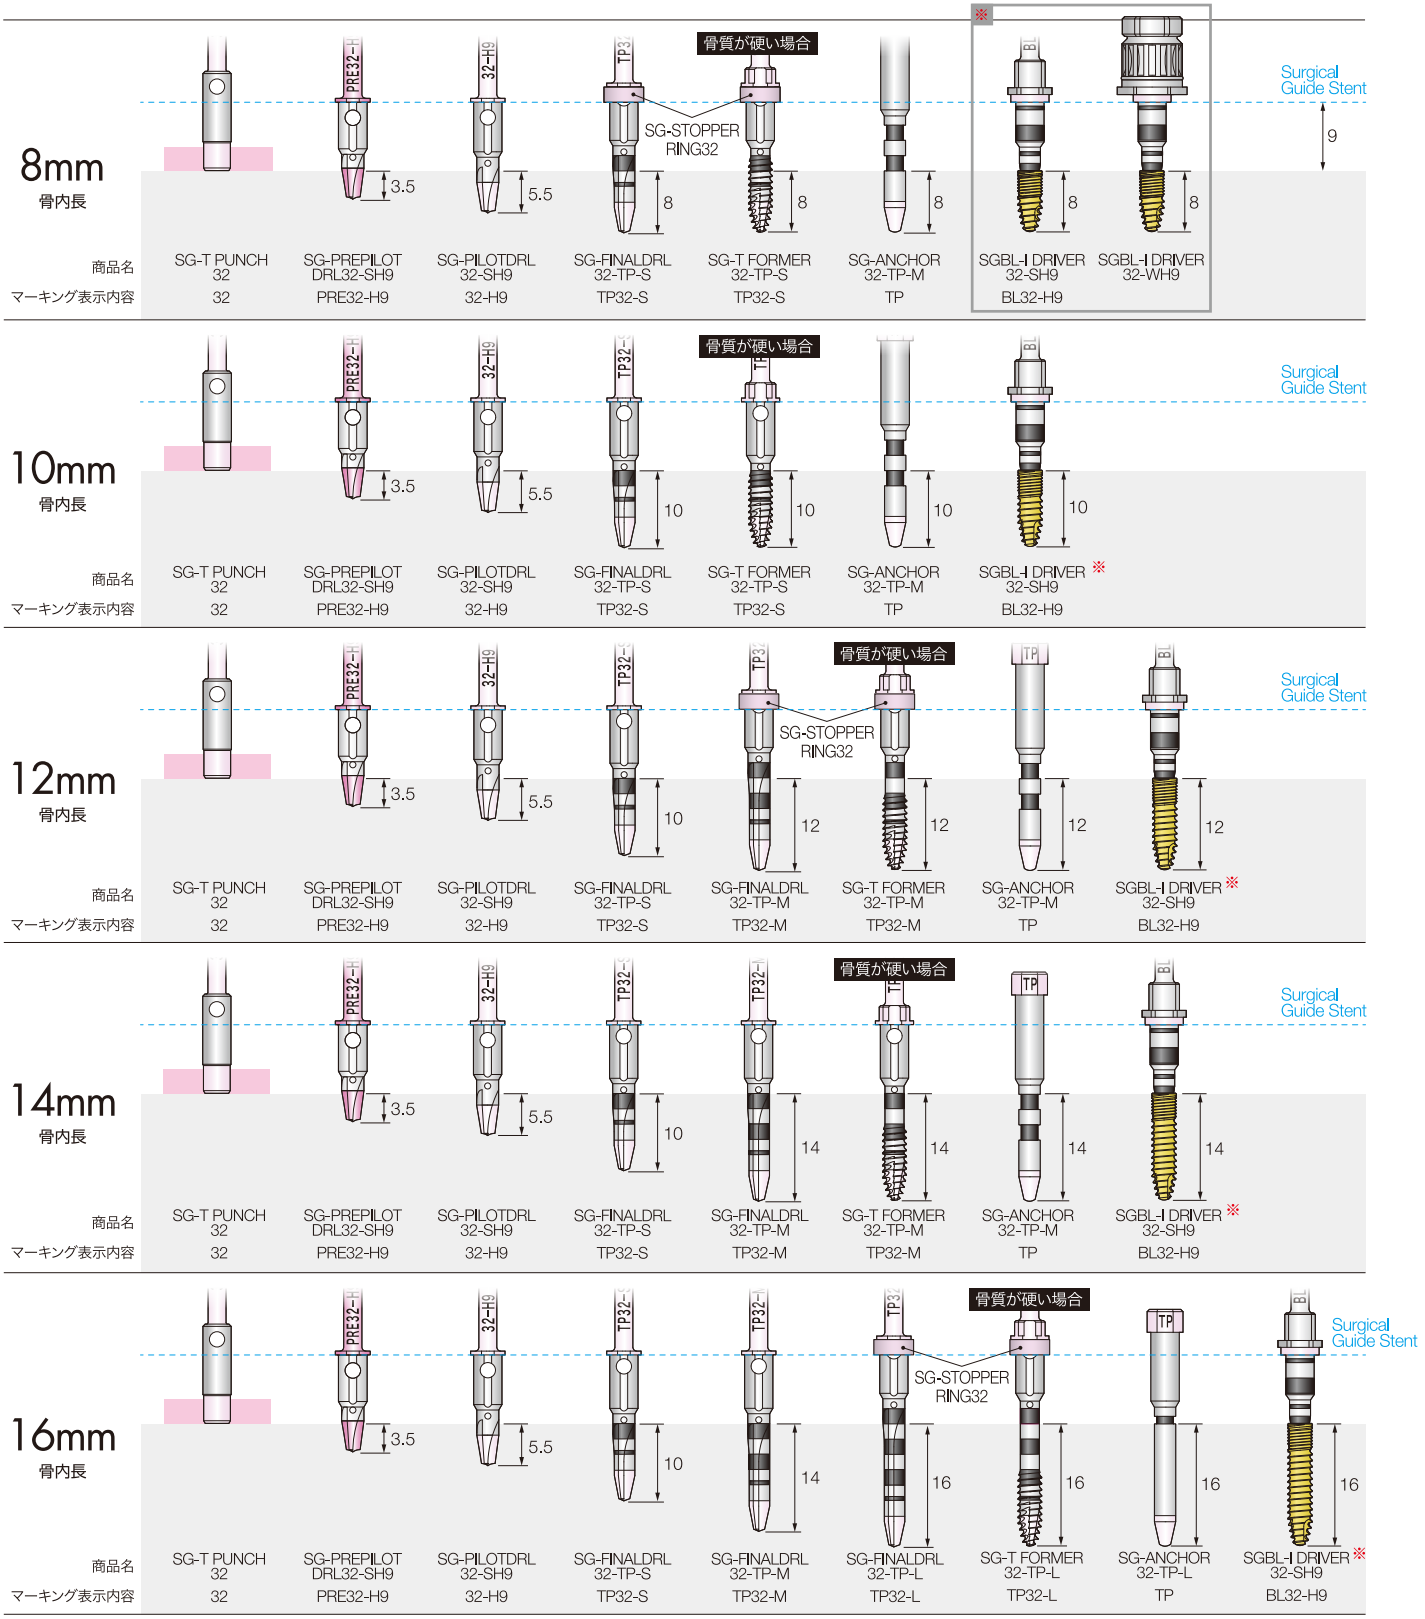

1P：1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.4mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

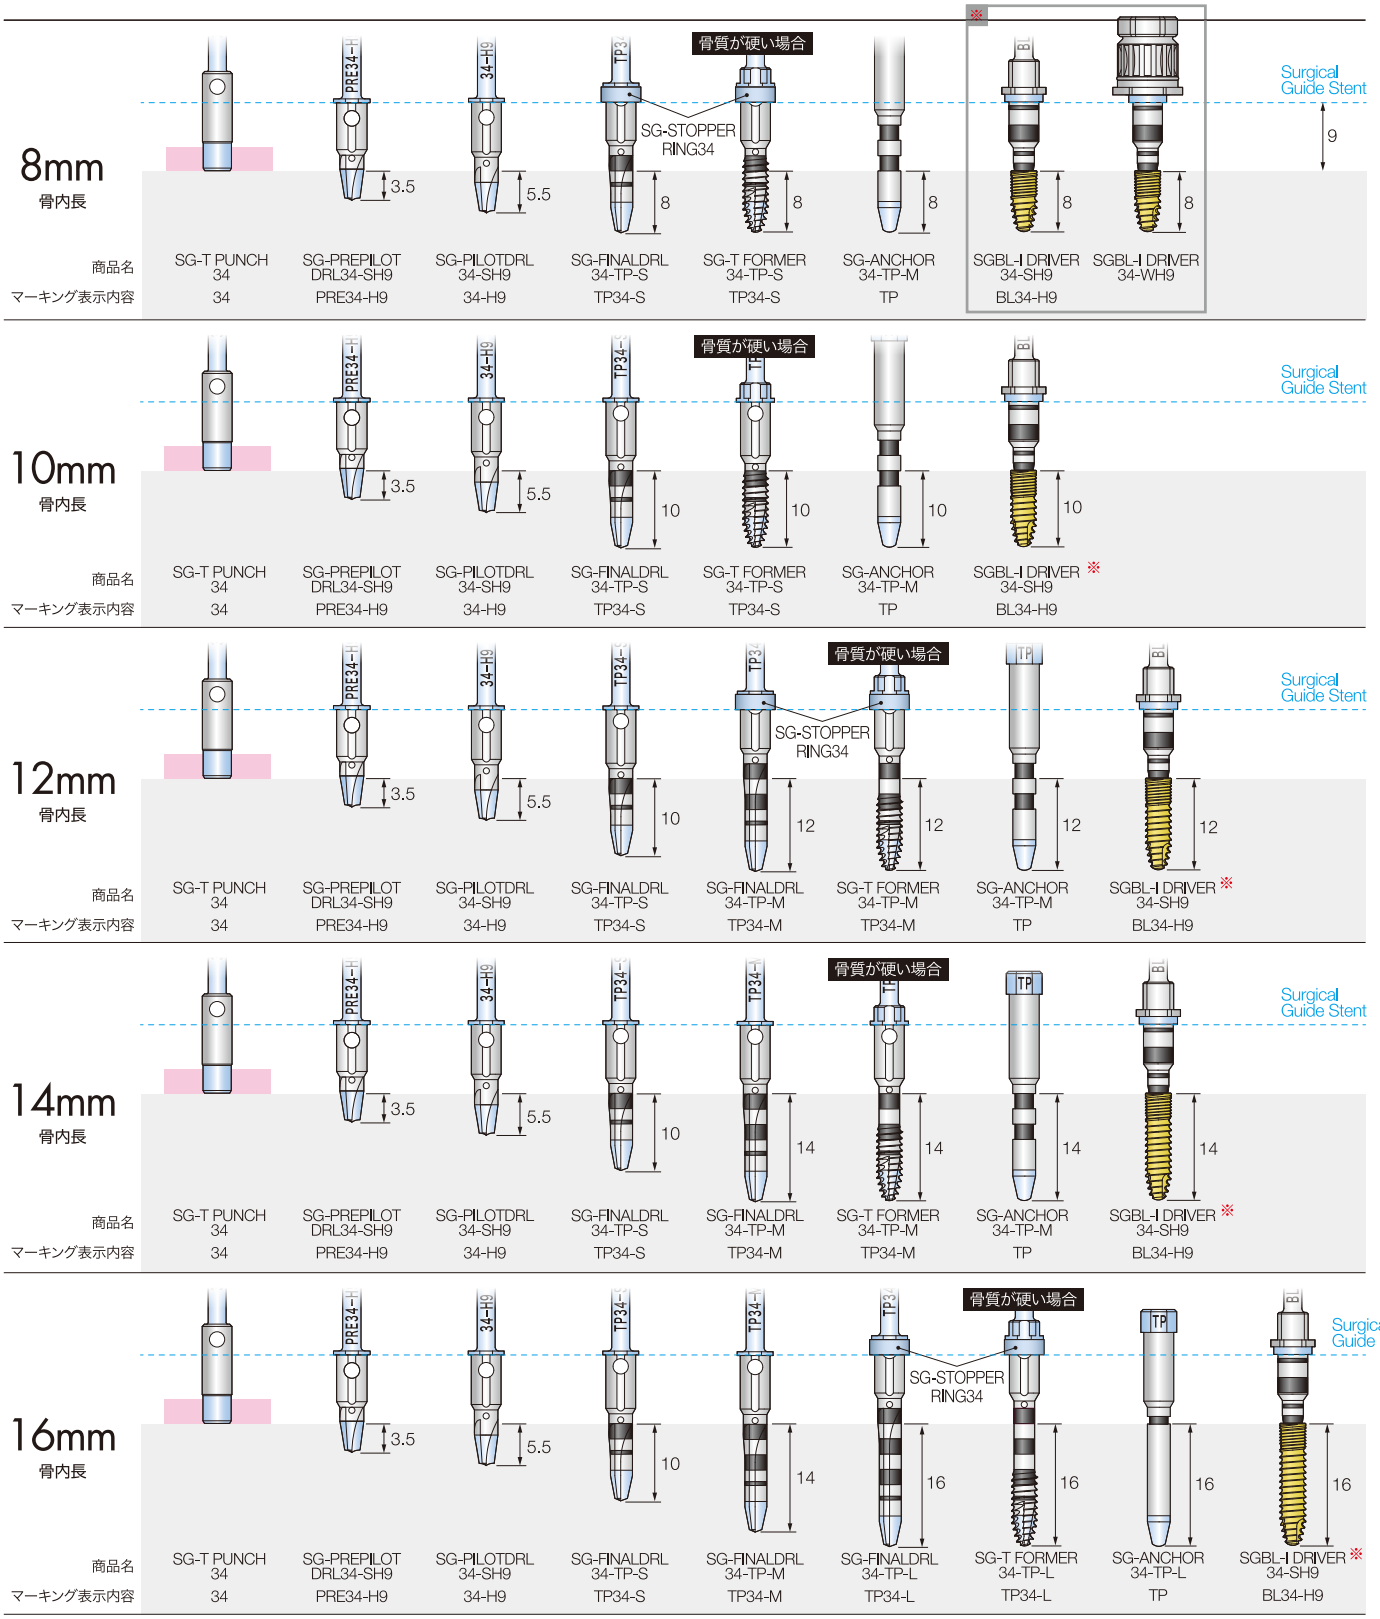

1P：1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

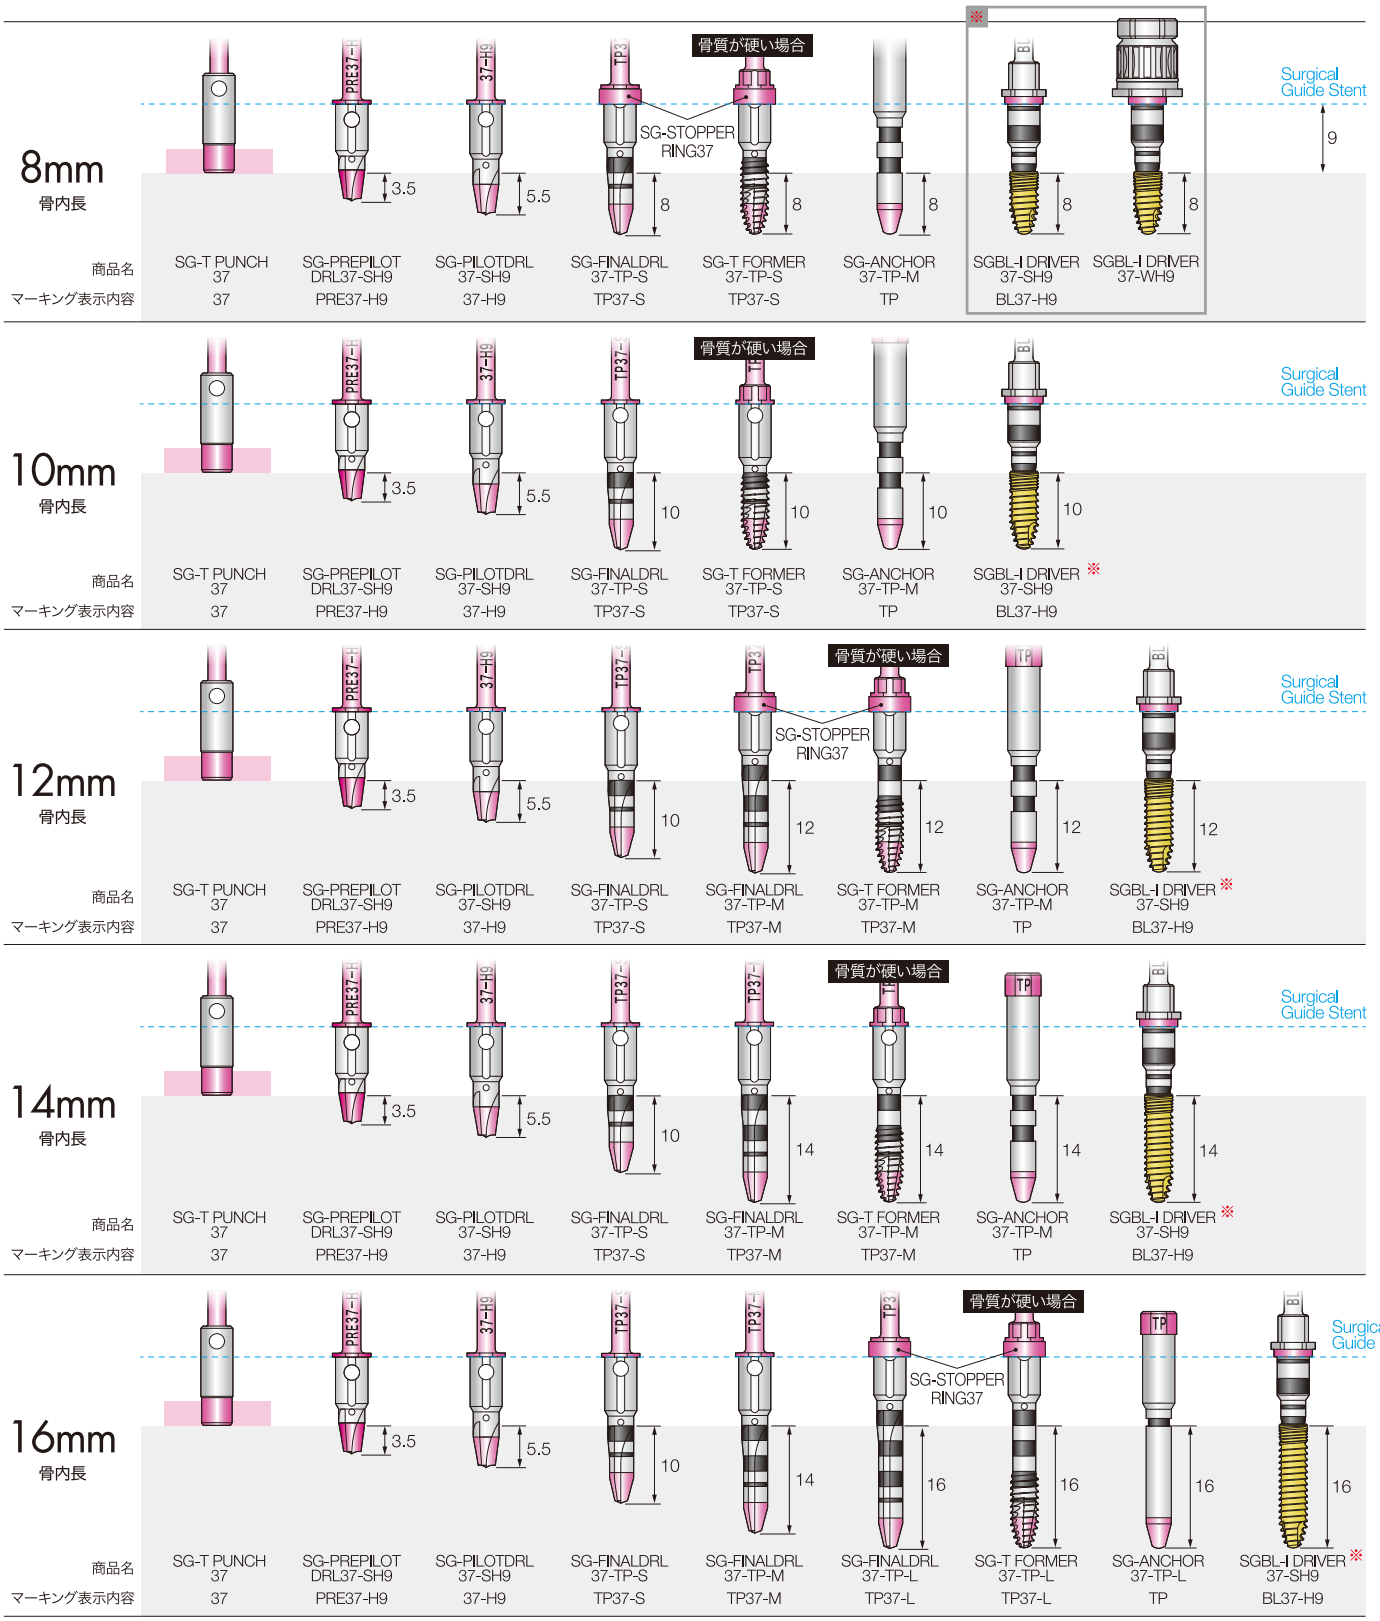

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA® Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ4.2mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

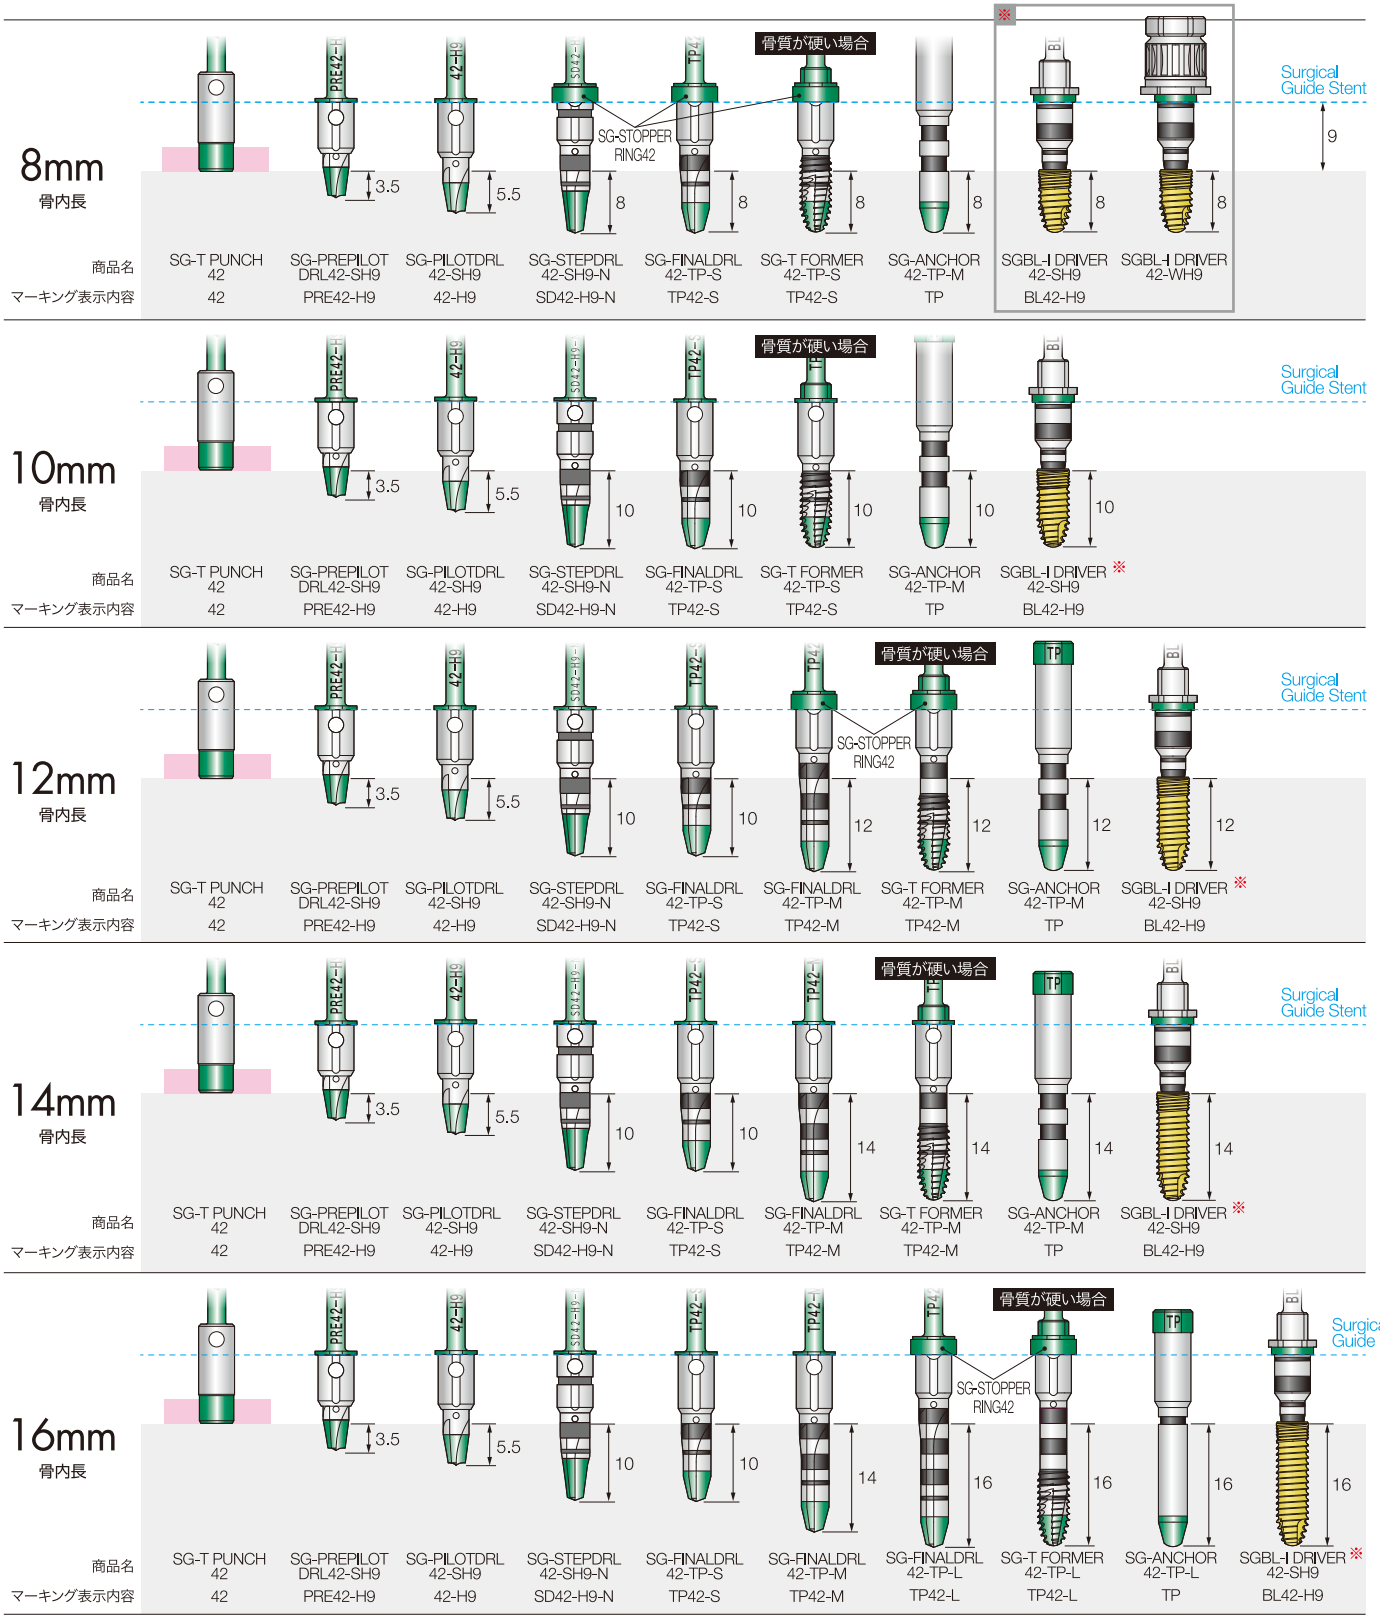

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA® Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ4.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

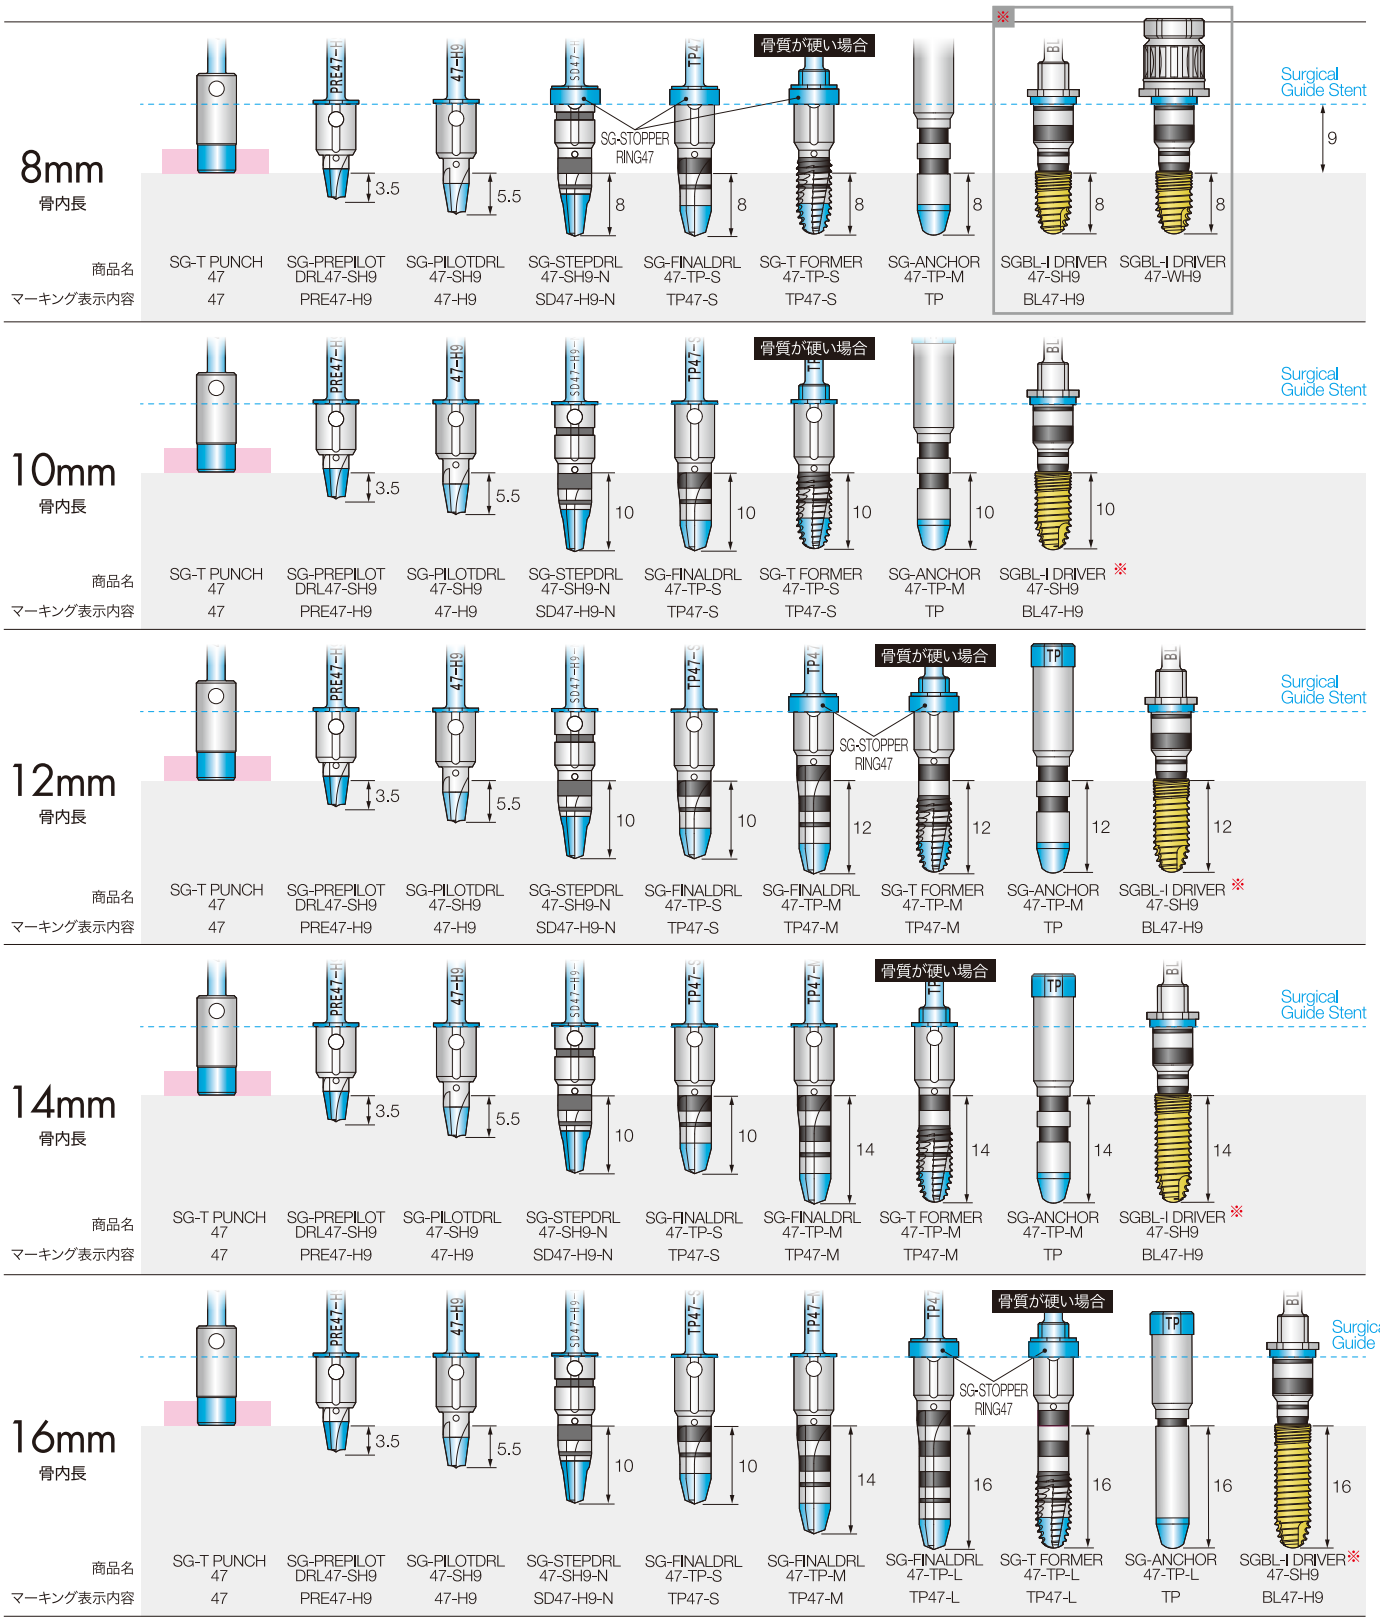

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

9mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA® Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ5.2mm

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

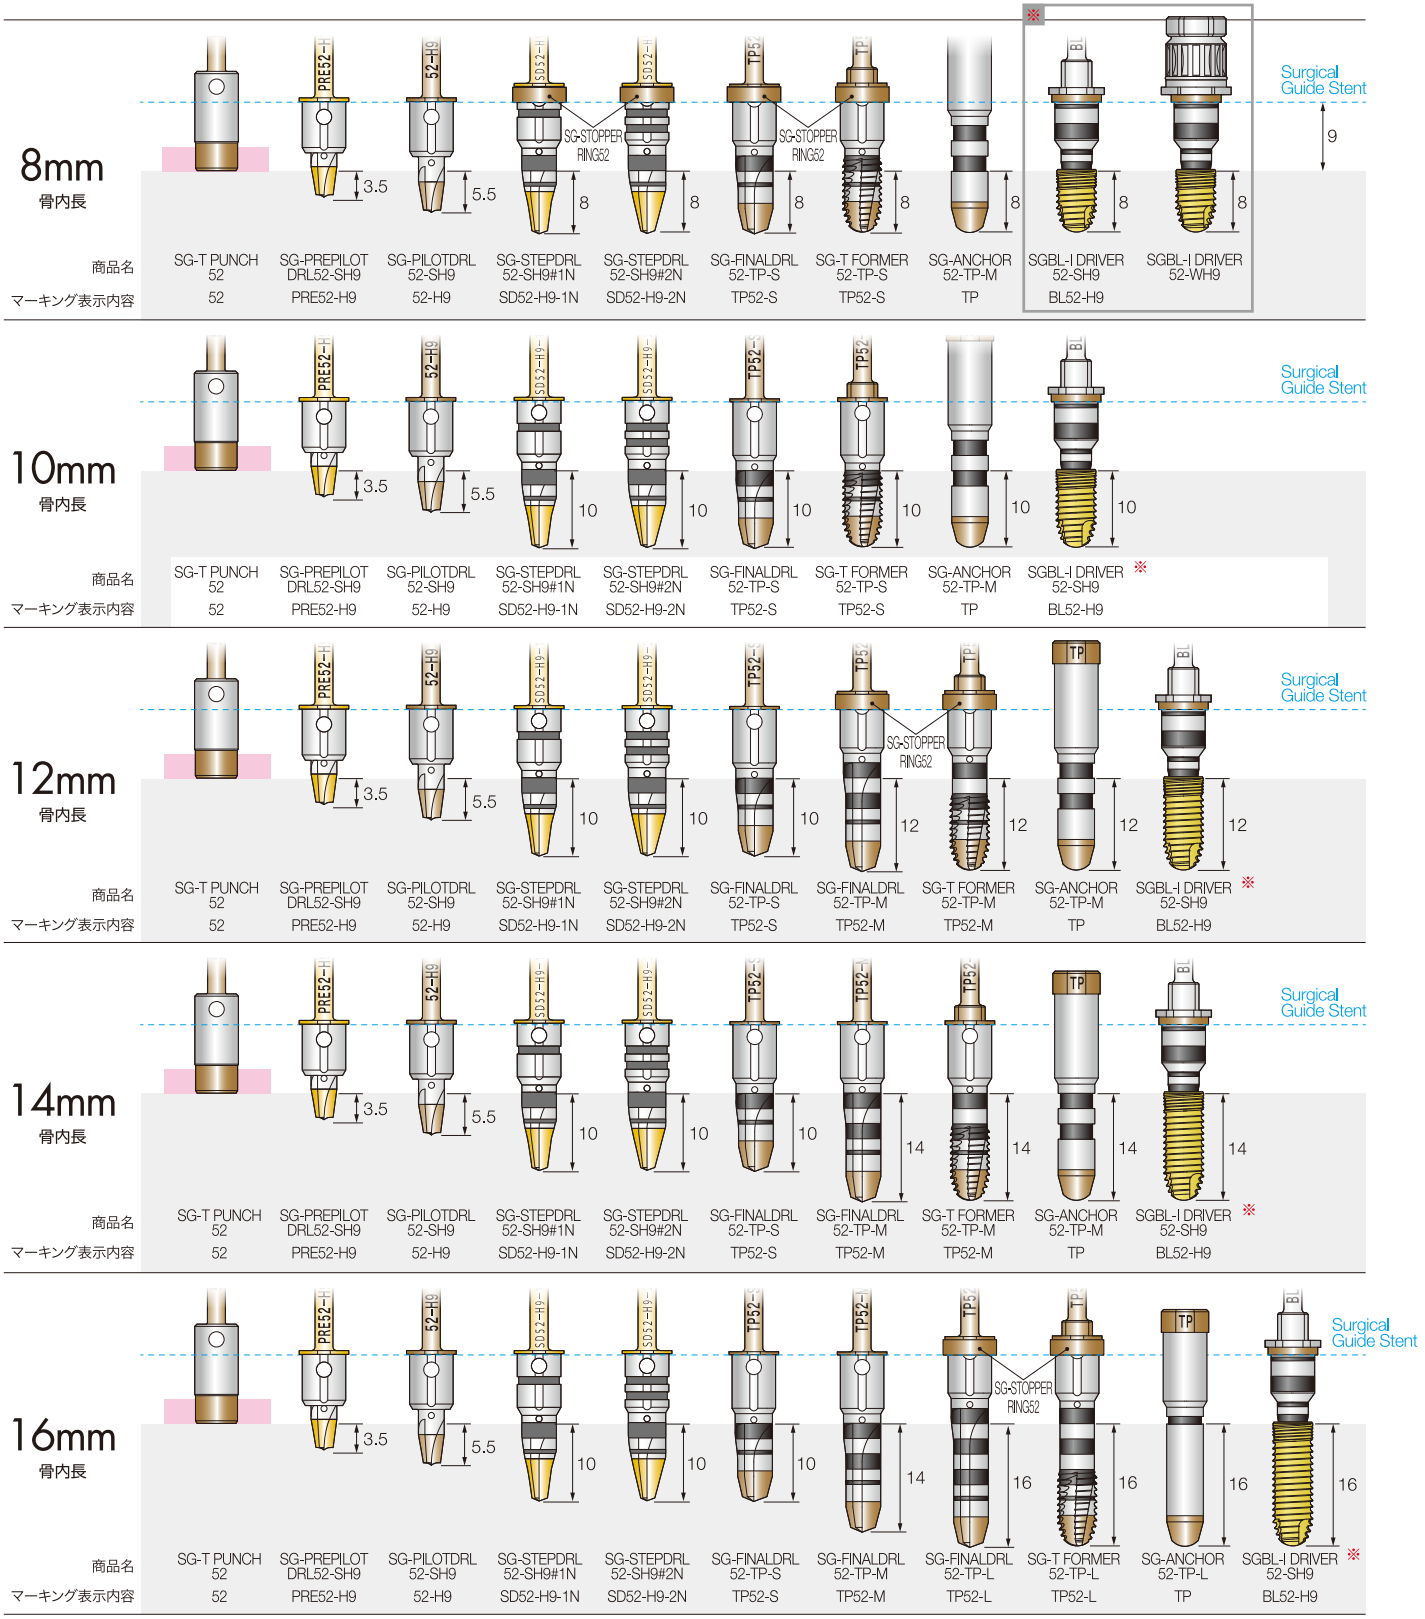

TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ 11mm

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type 術式チャート

11mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.0mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm
骨内長

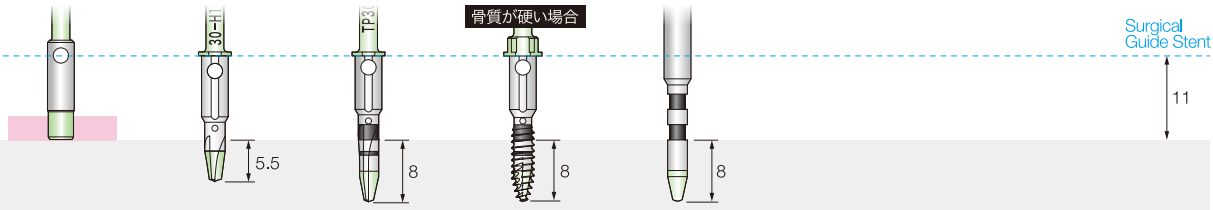

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH11-N	SG-FINALDRL 30-TP-S	SG-T FORMER 30-TP-S	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H11(N)	TP30-S	TP30-S	TP

10mm
骨内長

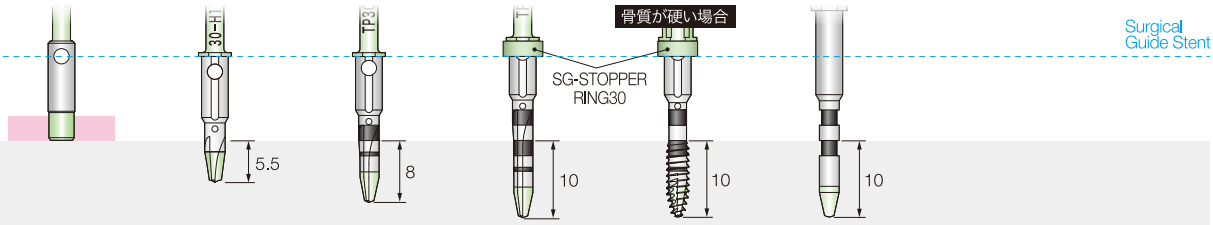

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH11-N	SG-FINALDRL 30-TP-S	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-T FORMER 30-TP-M	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H11(N)	TP30-S	TP30-M	TP30-M	TP

12mm
骨内長

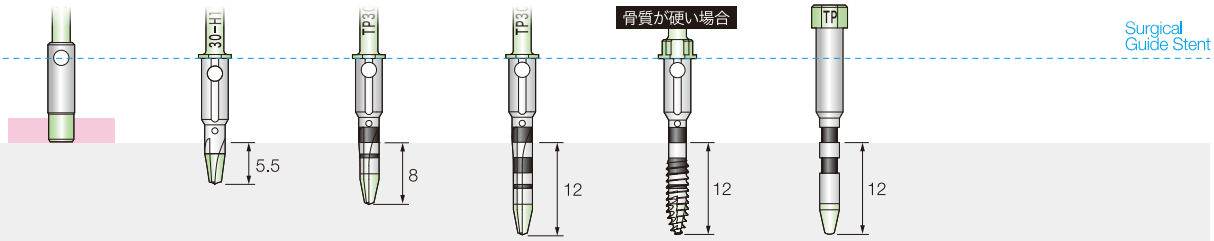

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH11-N	SG-FINALDRL 30-TP-S	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-T FORMER 30-TP-M	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H11(N)	TP30-S	TP30-M	TP30-M	TP

14mm
骨内長

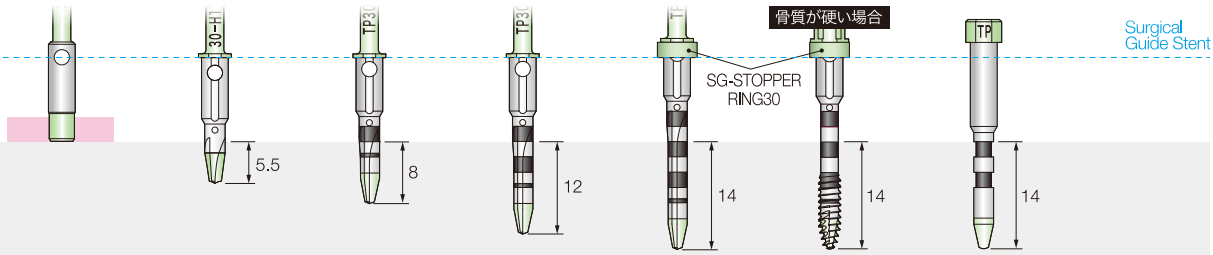

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH11-N	SG-FINALDRL 30-TP-S	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-FINALDRL 30-TP-L	SG-T FORMER 30-TP-L	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H11(N)	TP30-S	TP30-M	TP30-L	TP30-L	TP

1P:1Piece

単位 :mm

11mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.2mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

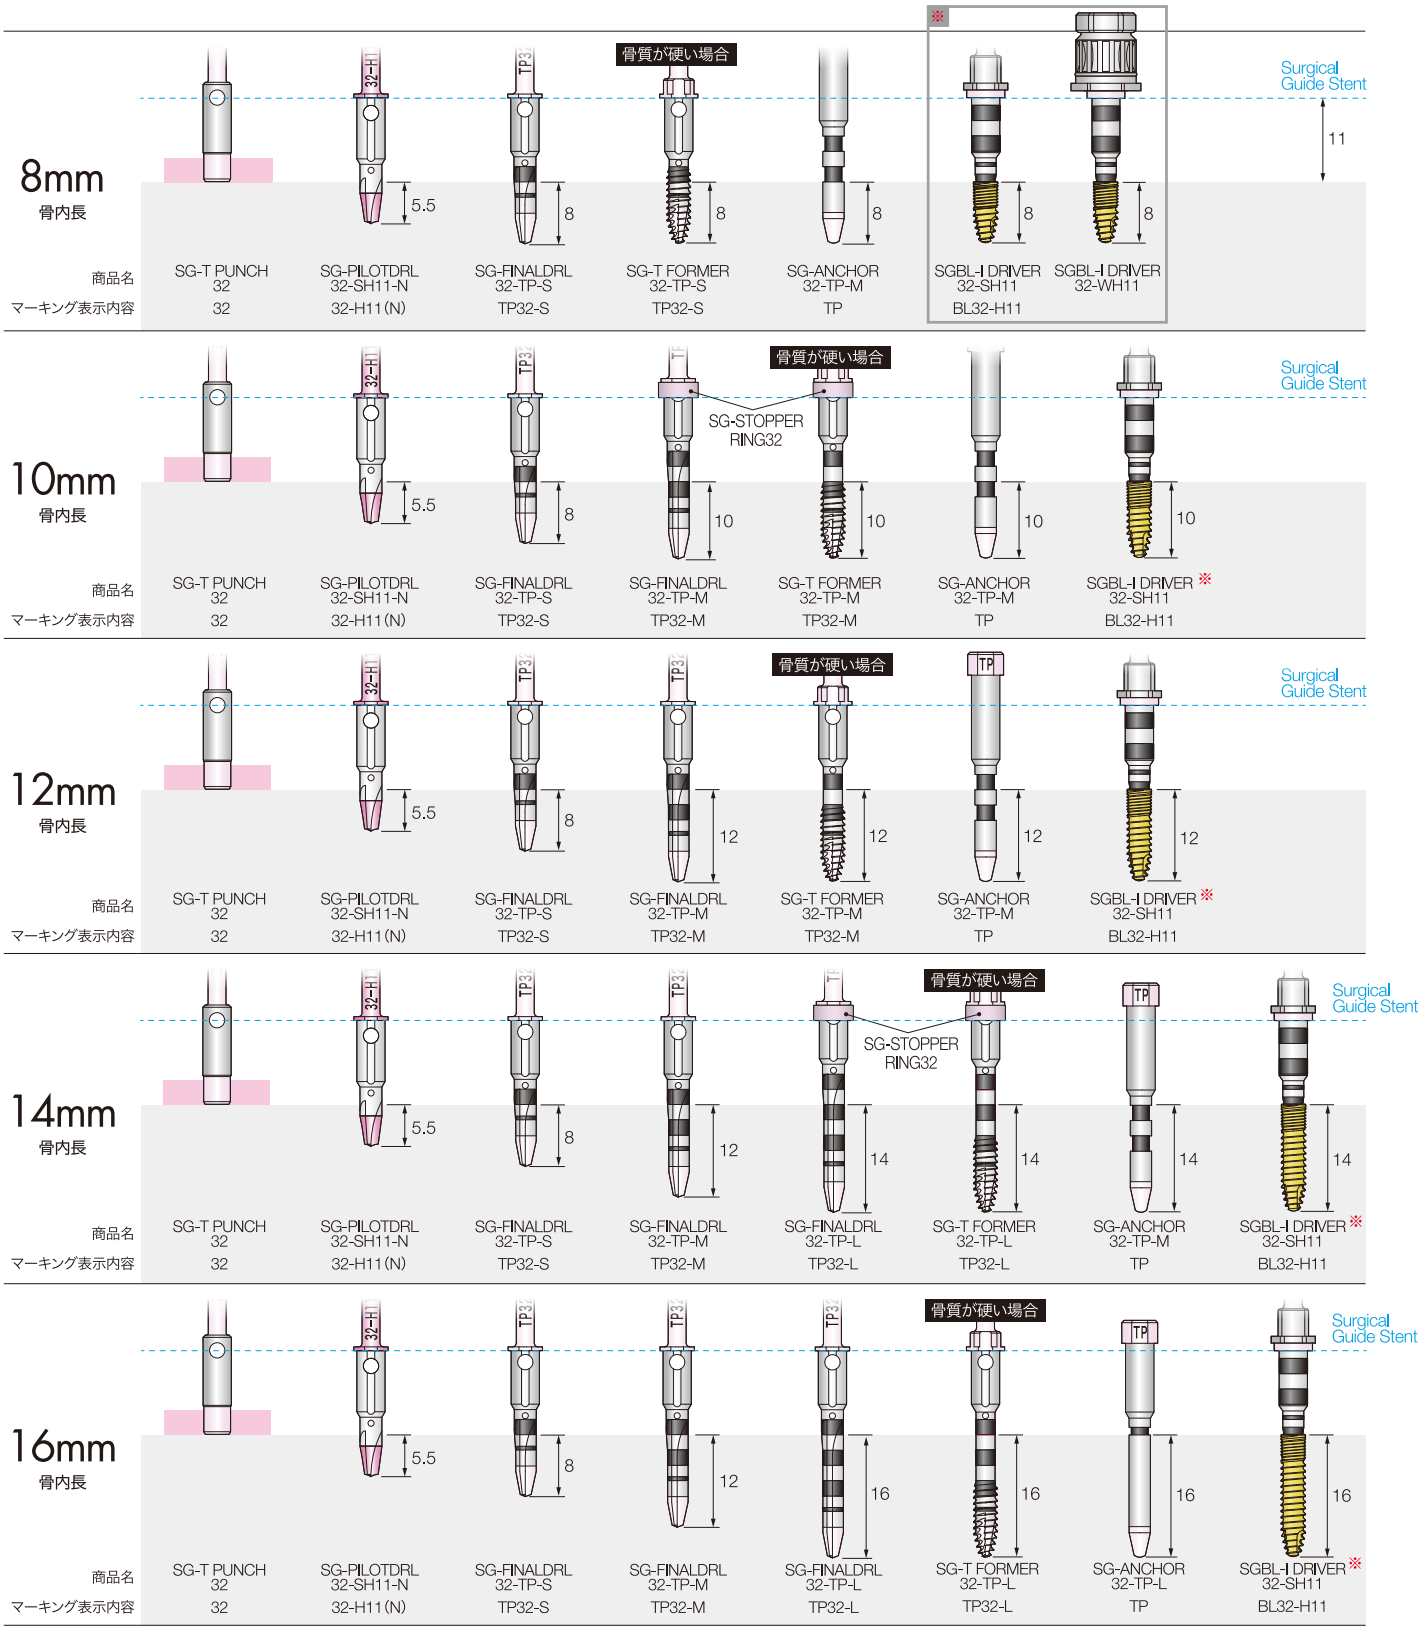

1P：1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.4mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

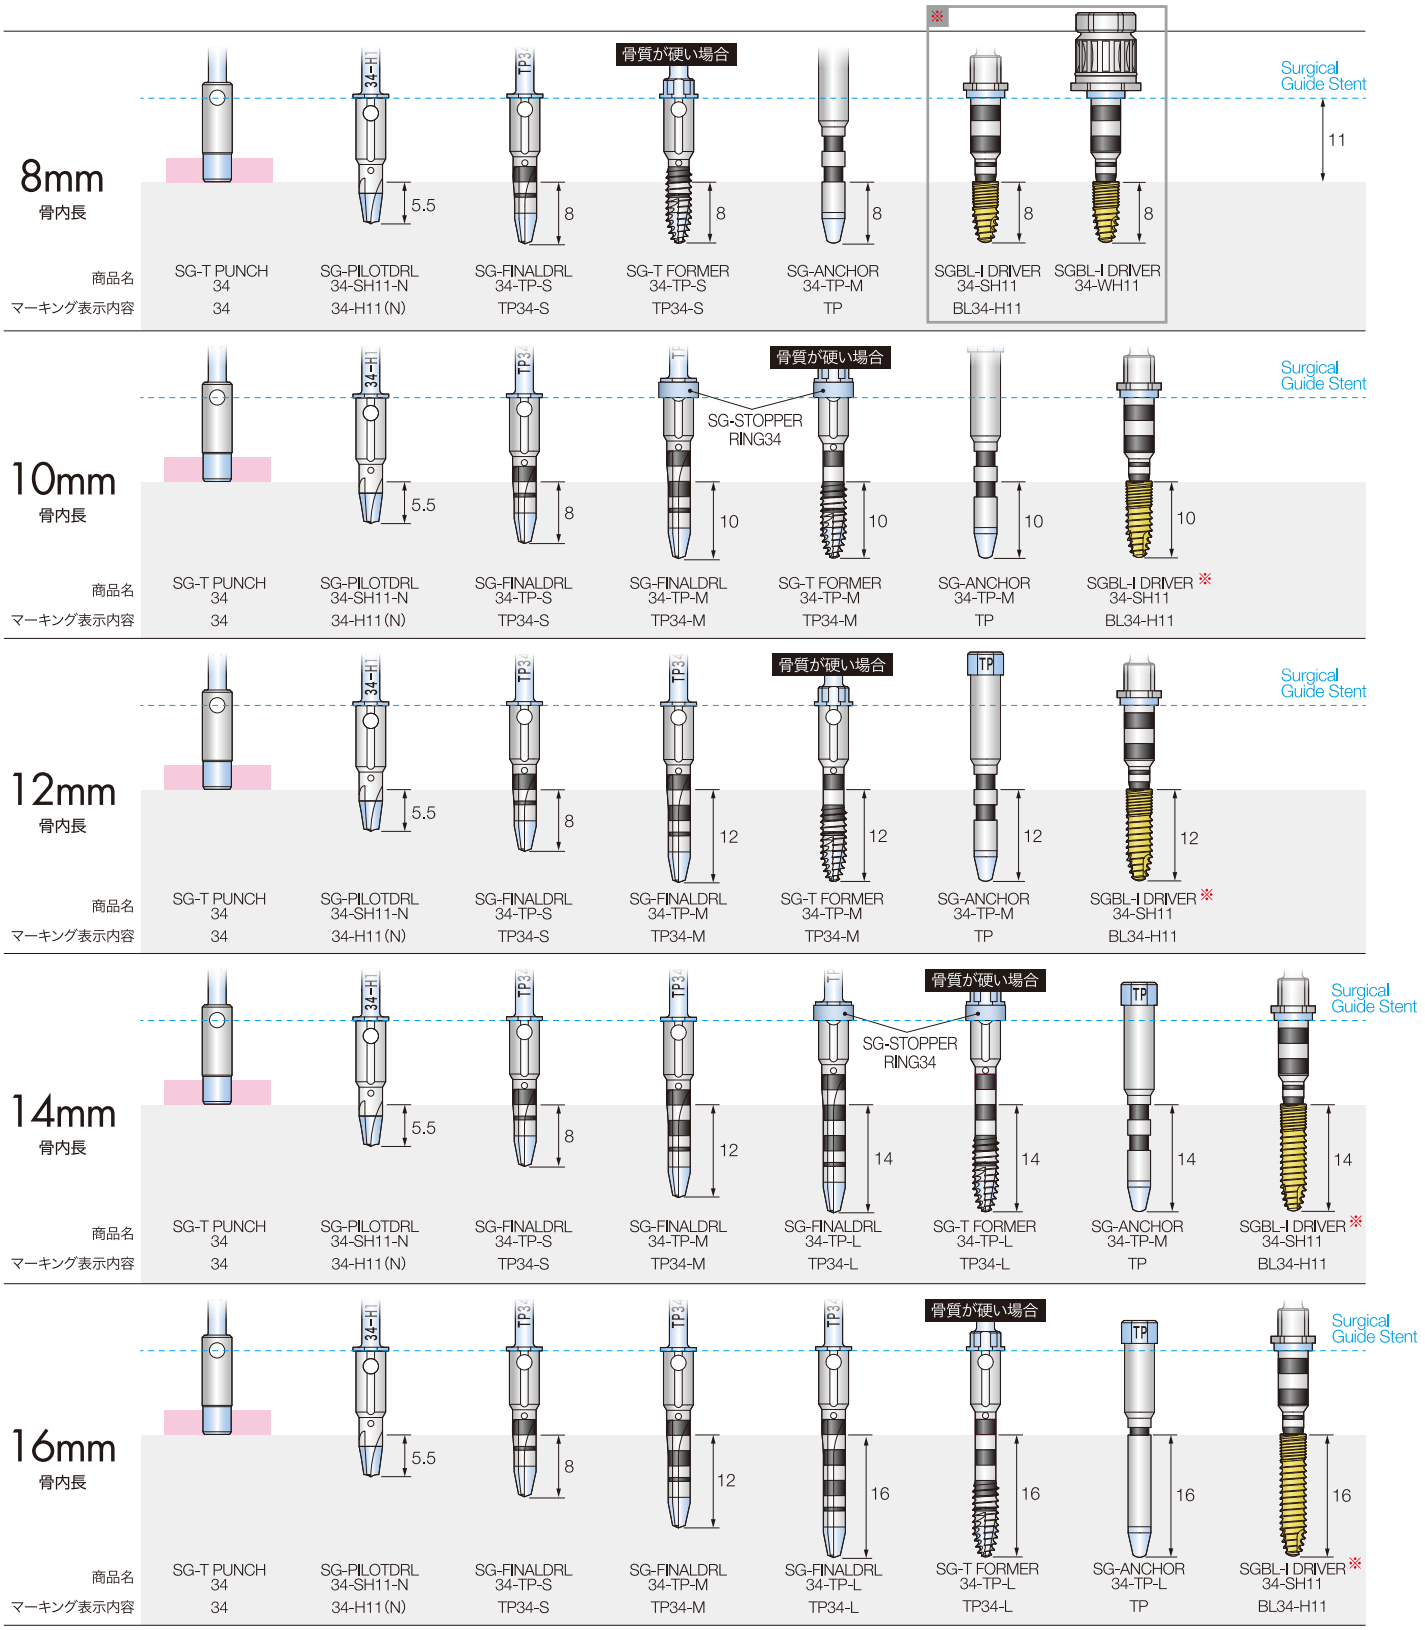

1P：1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

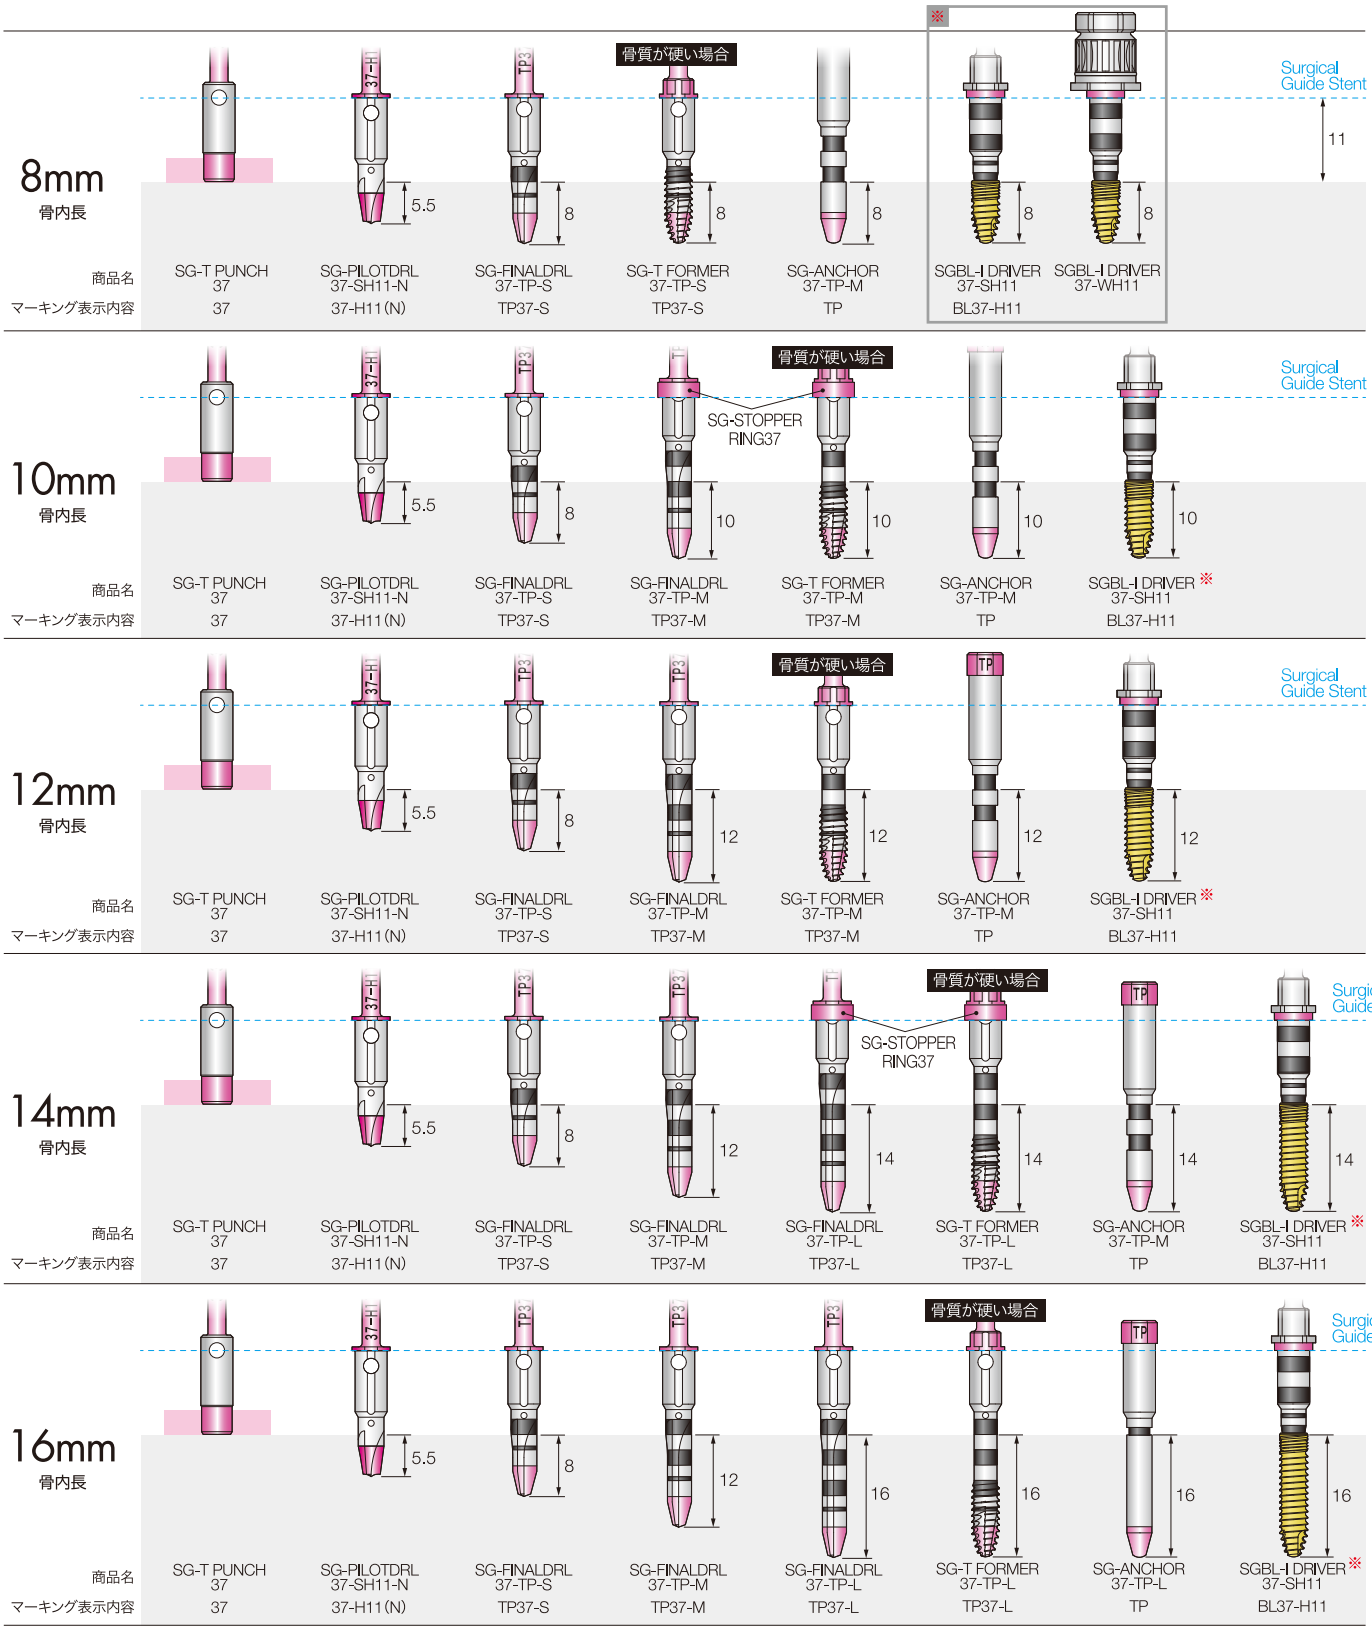

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ4.2mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

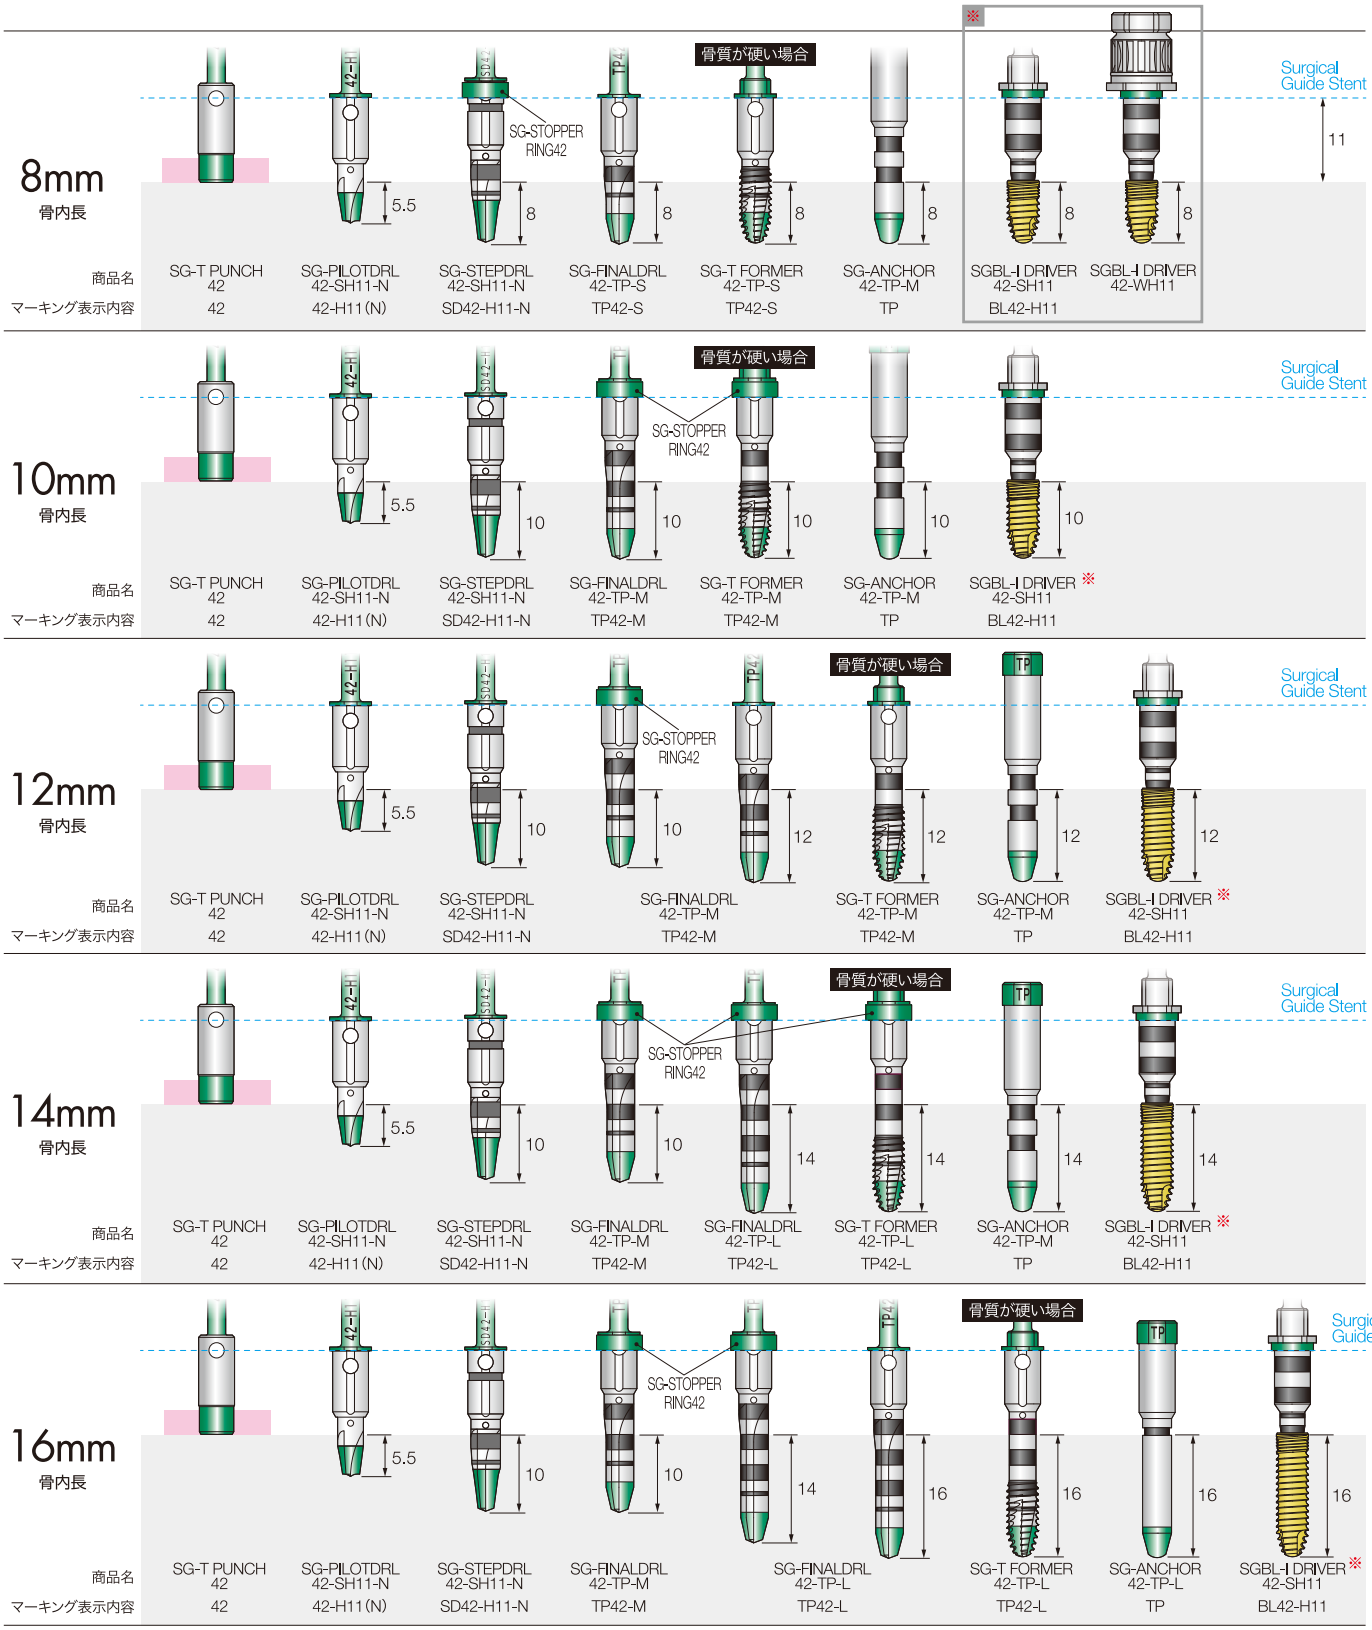

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ4.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

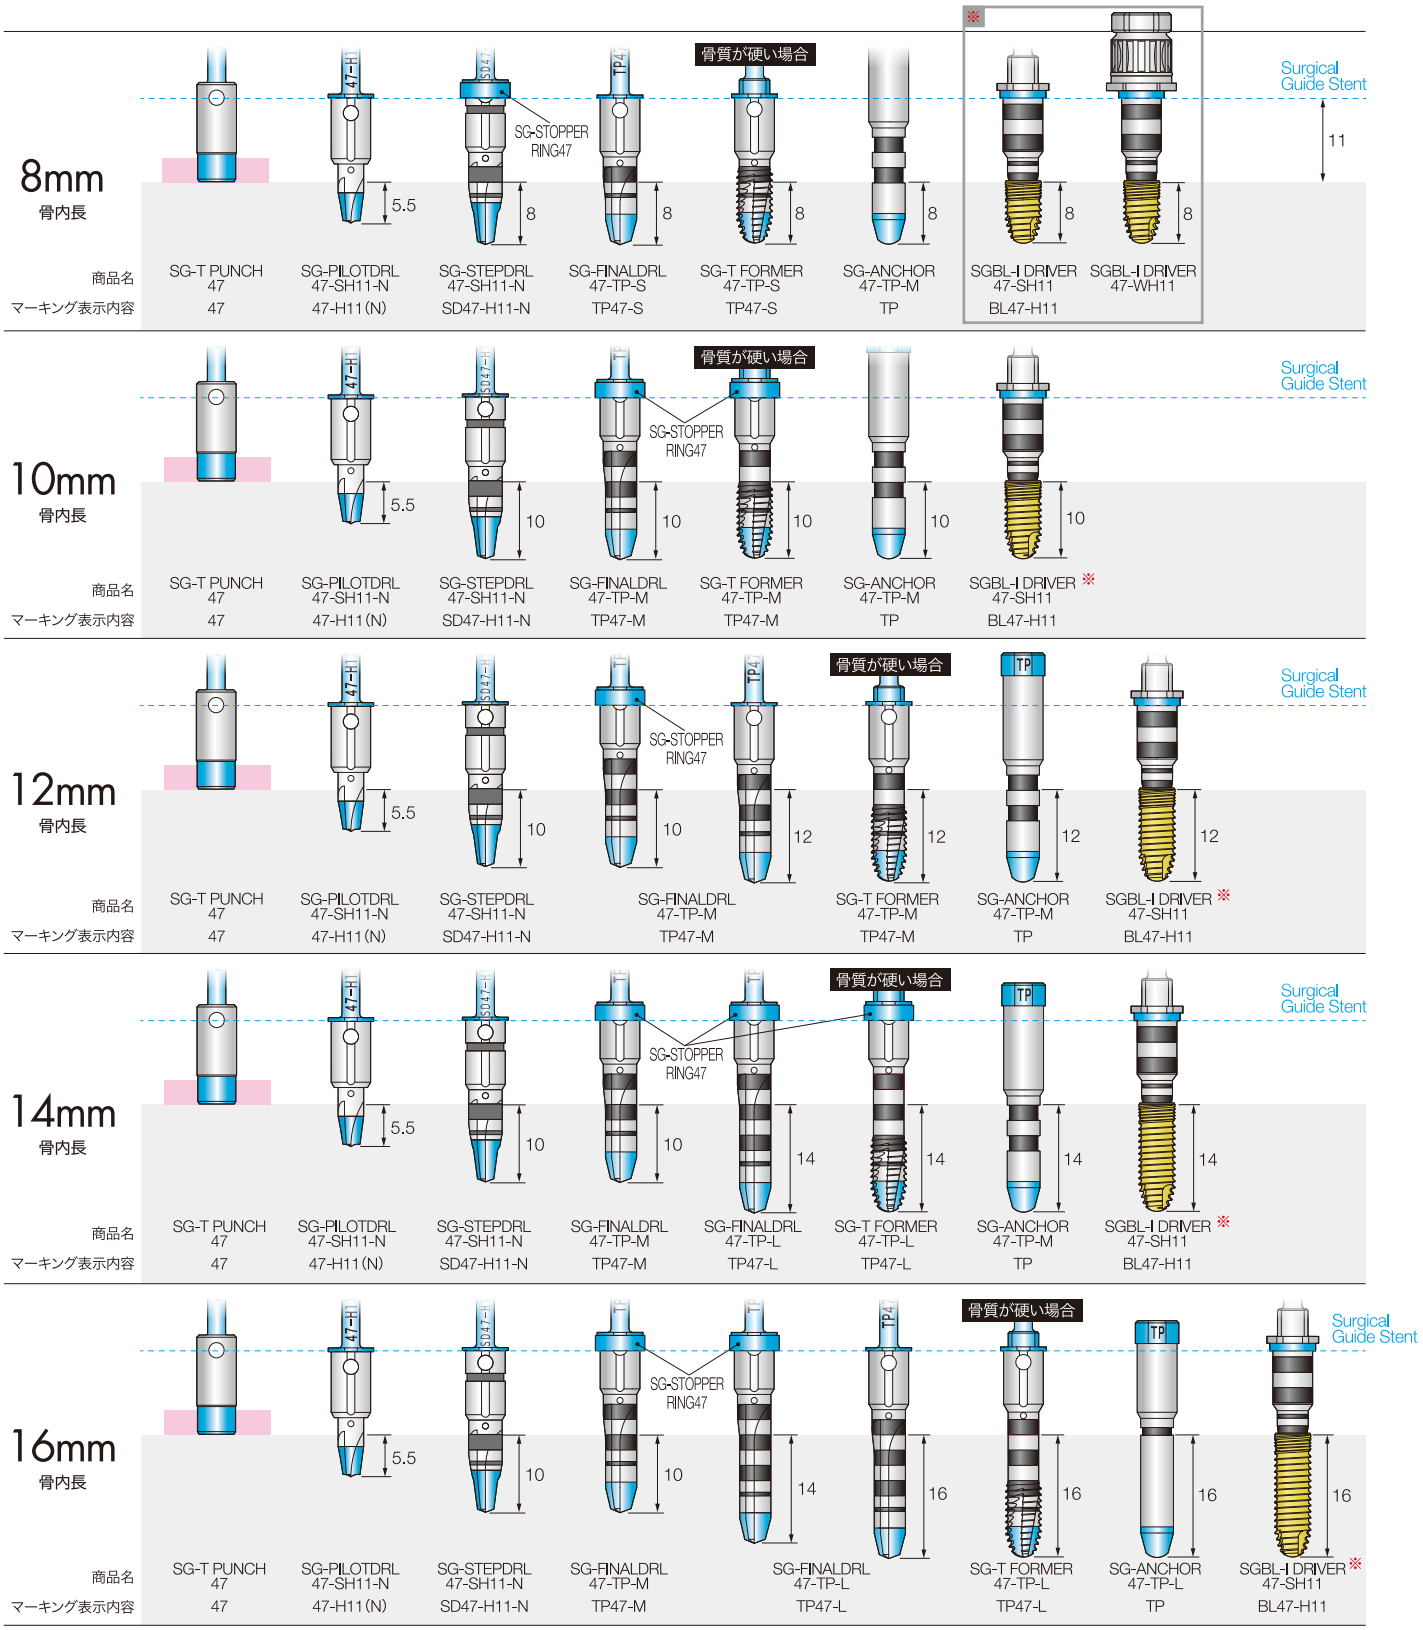

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

11mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ5.2mm

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

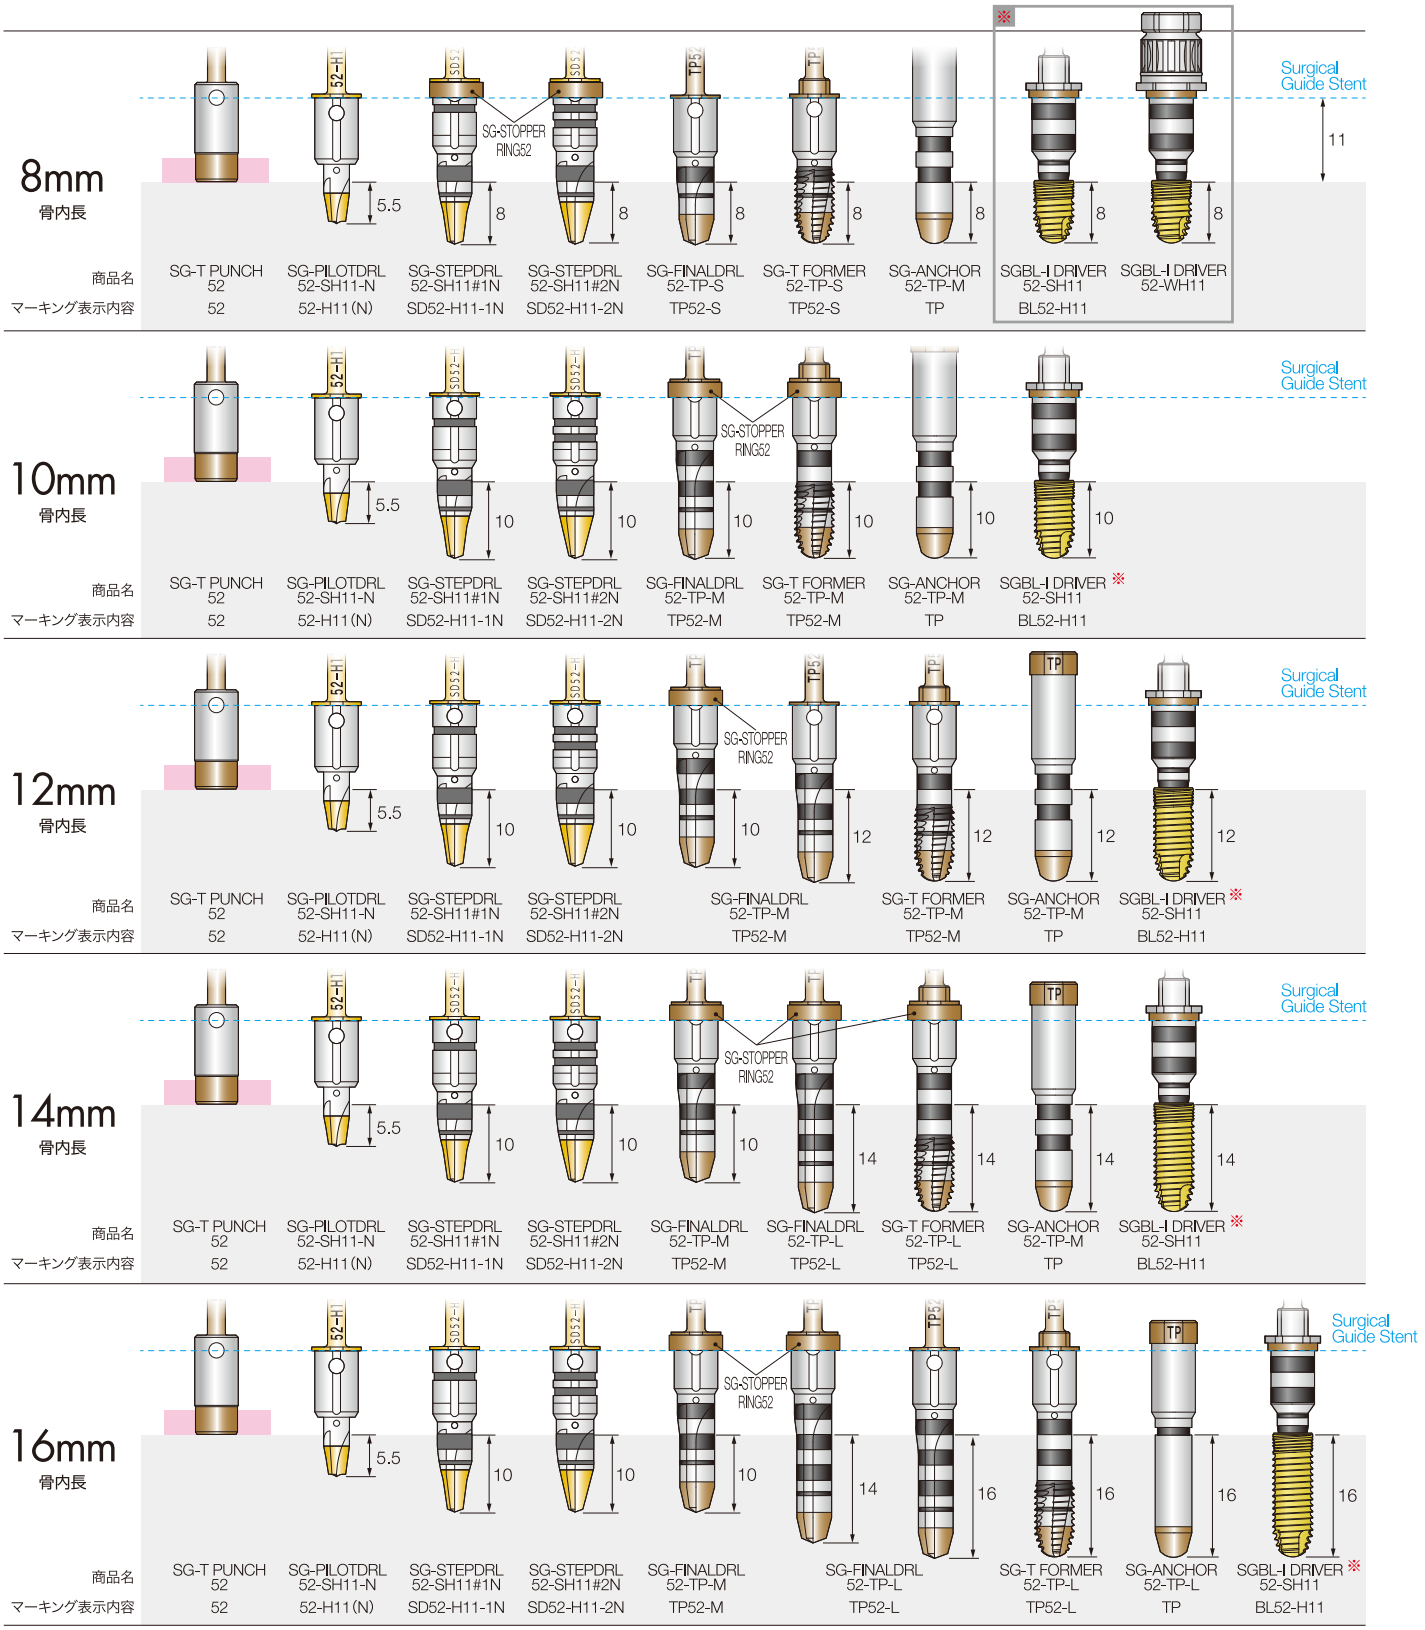

TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

サージカルガイドステント高さ 13mm

FINESIA®

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart

Tapered type 術式チャート

13mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.0mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm
骨内長

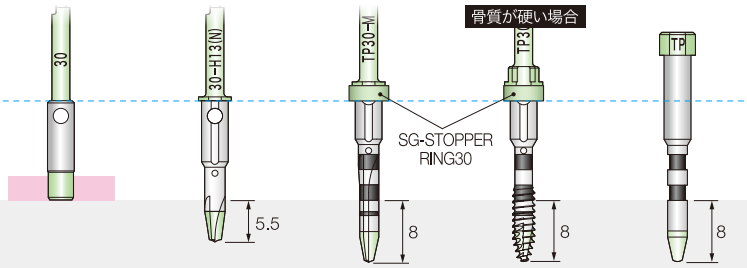

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH13-N	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-T FORMER 30-TP-M	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H13(N)	TP30-M	TP30-M	TP

10mm
骨内長

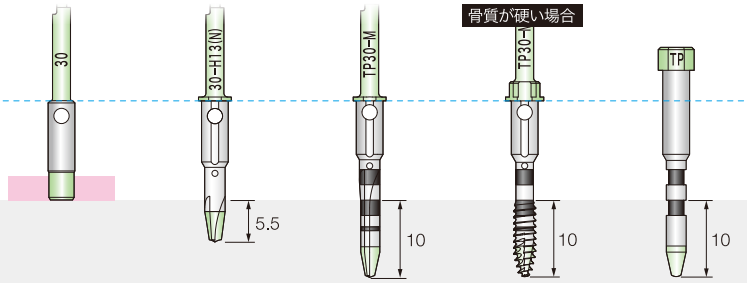

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH13-N	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-T FORMER 30-TP-M	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H13(N)	TP30-M	TP30-M	TP

12mm
骨内長

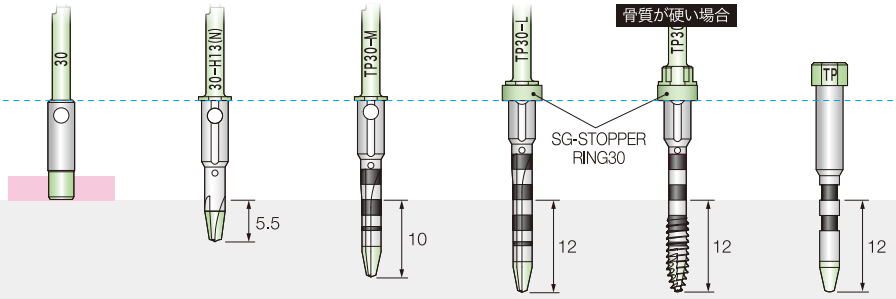

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH13-N	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-FINALDRL 30-TP-L	SG-T FORMER 30-TP-L	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H13(N)	TP30-M	TP30-L	TP30-L	TP

14mm
骨内長

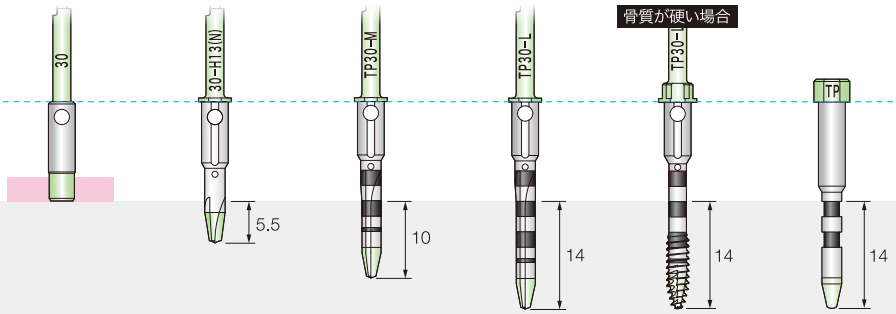

商品名	SG-T PUNCH 30	SG-PILOTDRL 30-SH13-N	SG-FINALDRL 30-TP-M	SG-FINALDRL 30-TP-L	SG-T FORMER 30-TP-L	SG-ANCHOR 30-TP-M
マーキング表示内容	30	30-H13(N)	TP30-M	TP30-L	TP30-L	TP

1P：1Piece

単位 :mm

13mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.2mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm
骨内長

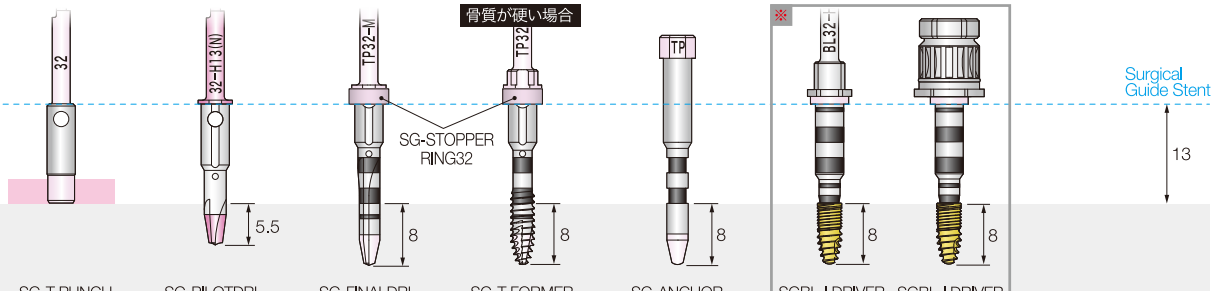

商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRL 32-SH13-N	SG-FINALDRL 32-TP-M	SG-T FORMER 32-TP-M	SG-ANCHOR 32-TP-M	SGBL-I DRIVER 32-SH13	SGBL-I DRIVER 32-WH13
マーキング表示内容	32	32-H13(N)	TP32-M	TP32-M	TP	BL32-H13	

10mm
骨内長

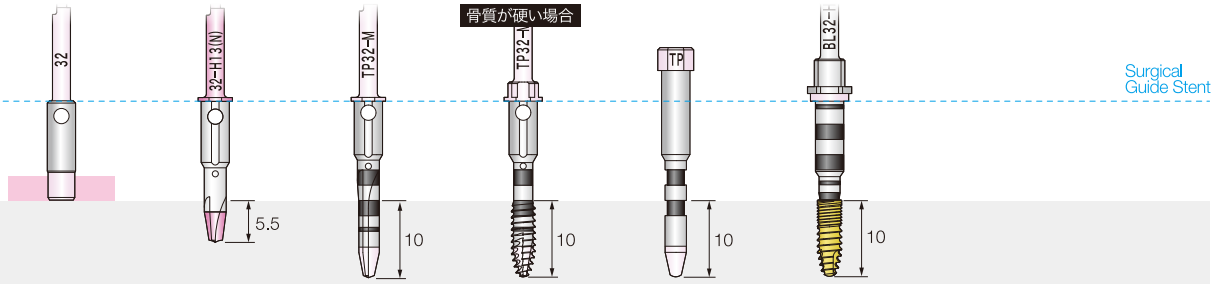

商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRL 32-SH13-N	SG-FINALDRL 32-TP-M	SG-T FORMER 32-TP-M	SG-ANCHOR 32-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 32-SH13
マーキング表示内容	32	32-H13(N)	TP32-M	TP32-M	TP	BL32-H13

12mm
骨内長

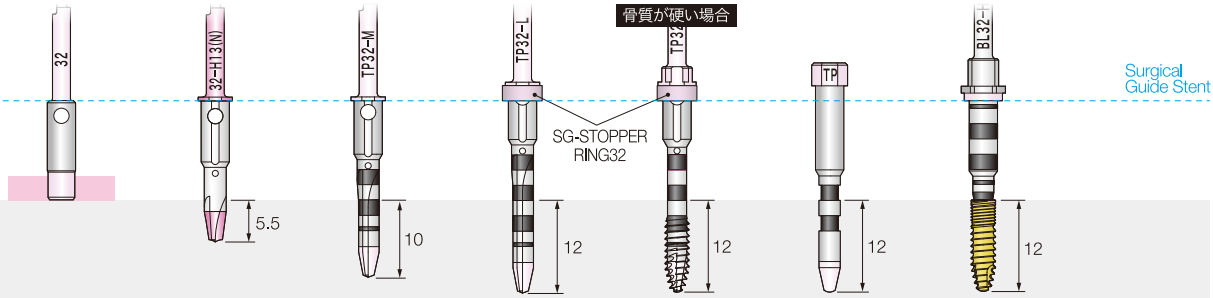

商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRL 32-SH13-N	SG-FINALDRL 32-TP-M	SG-FINALDRL 32-TP-L	SG-T FORMER 32-TP-L	SG-ANCHOR 32-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 32-SH13
マーキング表示内容	32	32-H13(N)	TP32-M	TP32-L	TP32-L	TP	BL32-H13

14mm
骨内長

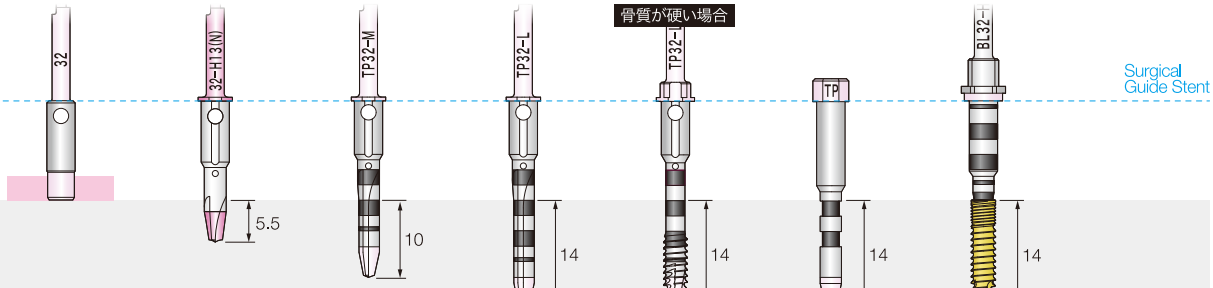

商品名	SG-T PUNCH 32	SG-PILOTDRL 32-SH13-N	SG-FINALDRL 32-TP-M	SG-FINALDRL 32-TP-L	SG-T FORMER 32-TP-L	SG-ANCHOR 32-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 32-SH13
マーキング表示内容	32	32-H13(N)	TP32-M	TP32-L	TP32-L	TP	BL32-H13

1P：1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント長さ

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.4mm

1Pタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm
骨内長

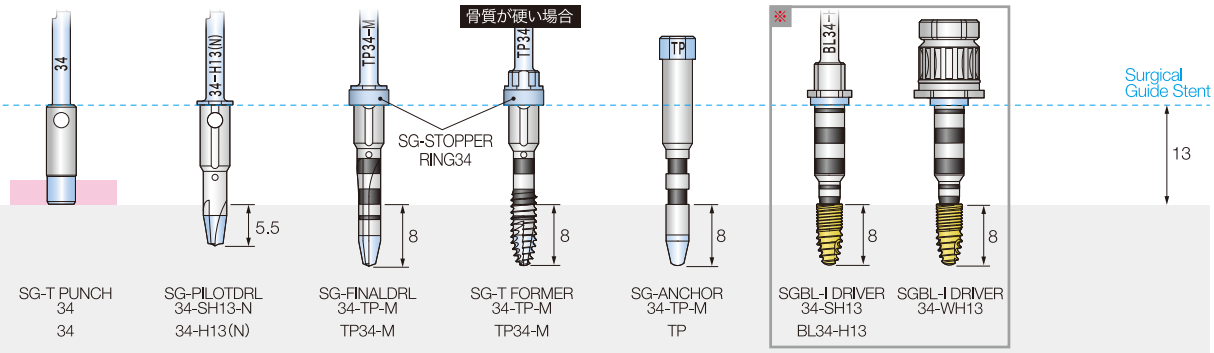

商品名	SG-T PUNCH 34	SG-PILOTDRL 34-SH13-N	SG-FINALDRL 34-TP-M	SG-T FORMER 34-TP-M	SG-ANCHOR 34-TP-M	SGBL-I DRIVER 34-SH13	SGBL-I DRIVER 34-WH13
マーキング表示内容	34	34-H13(N)	TP34-M	TP34-M	TP	BL34-H13	

10mm
骨内長

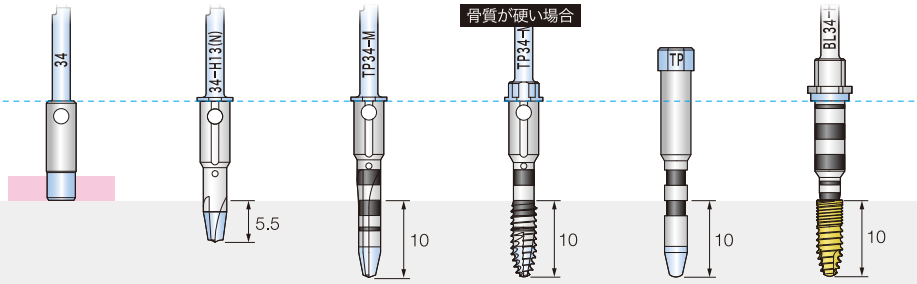

商品名	SG-T PUNCH 34	SG-PILOTDRL 34-SH13-N	SG-FINALDRL 34-TP-M	SG-T FORMER 34-TP-M	SG-ANCHOR 34-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 34-SH13
マーキング表示内容	34	34-H13(N)	TP34-M	TP34-M	TP	BL34-H13

12mm
骨内長

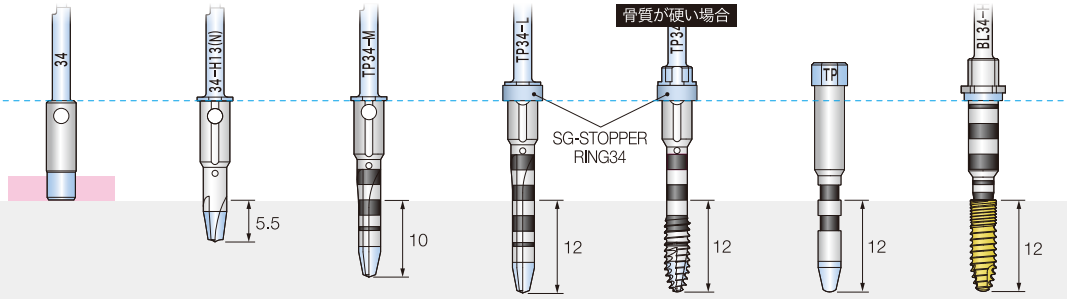

商品名	SG-T PUNCH 34	SG-PILOTDRL 34-SH13-N	SG-FINALDRL 34-TP-M	SG-FINALDRL 34-TP-L	SG-T FORMER 34-TP-L	SG-ANCHOR 34-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 34-SH13
マーキング表示内容	34	34-H13(N)	TP34-M	TP34-L	TP34-L	TP	BL34-H13

14mm
骨内長

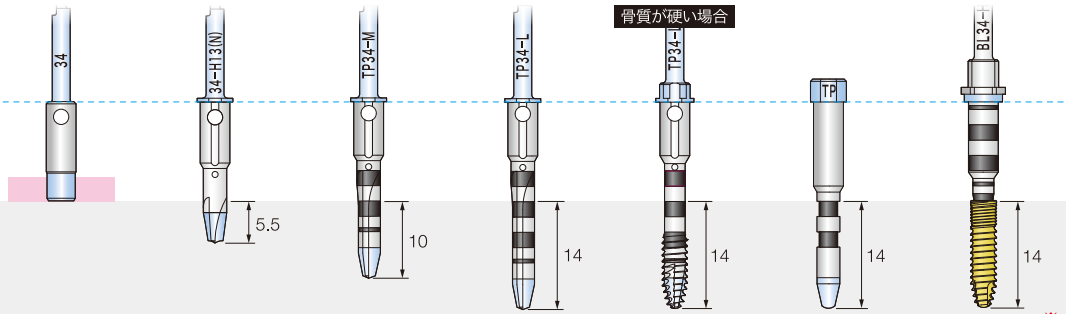

商品名	SG-T PUNCH 34	SG-PILOTDRL 34-SH13-N	SG-FINALDRL 34-TP-M	SG-FINALDRL 34-TP-L	SG-T FORMER 34-TP-L	SG-ANCHOR 34-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 34-SH13
マーキング表示内容	34	34-H13(N)	TP34-M	TP34-L	TP34-L	TP	BL34-H13

1P：1Piece

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント固定

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ3.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

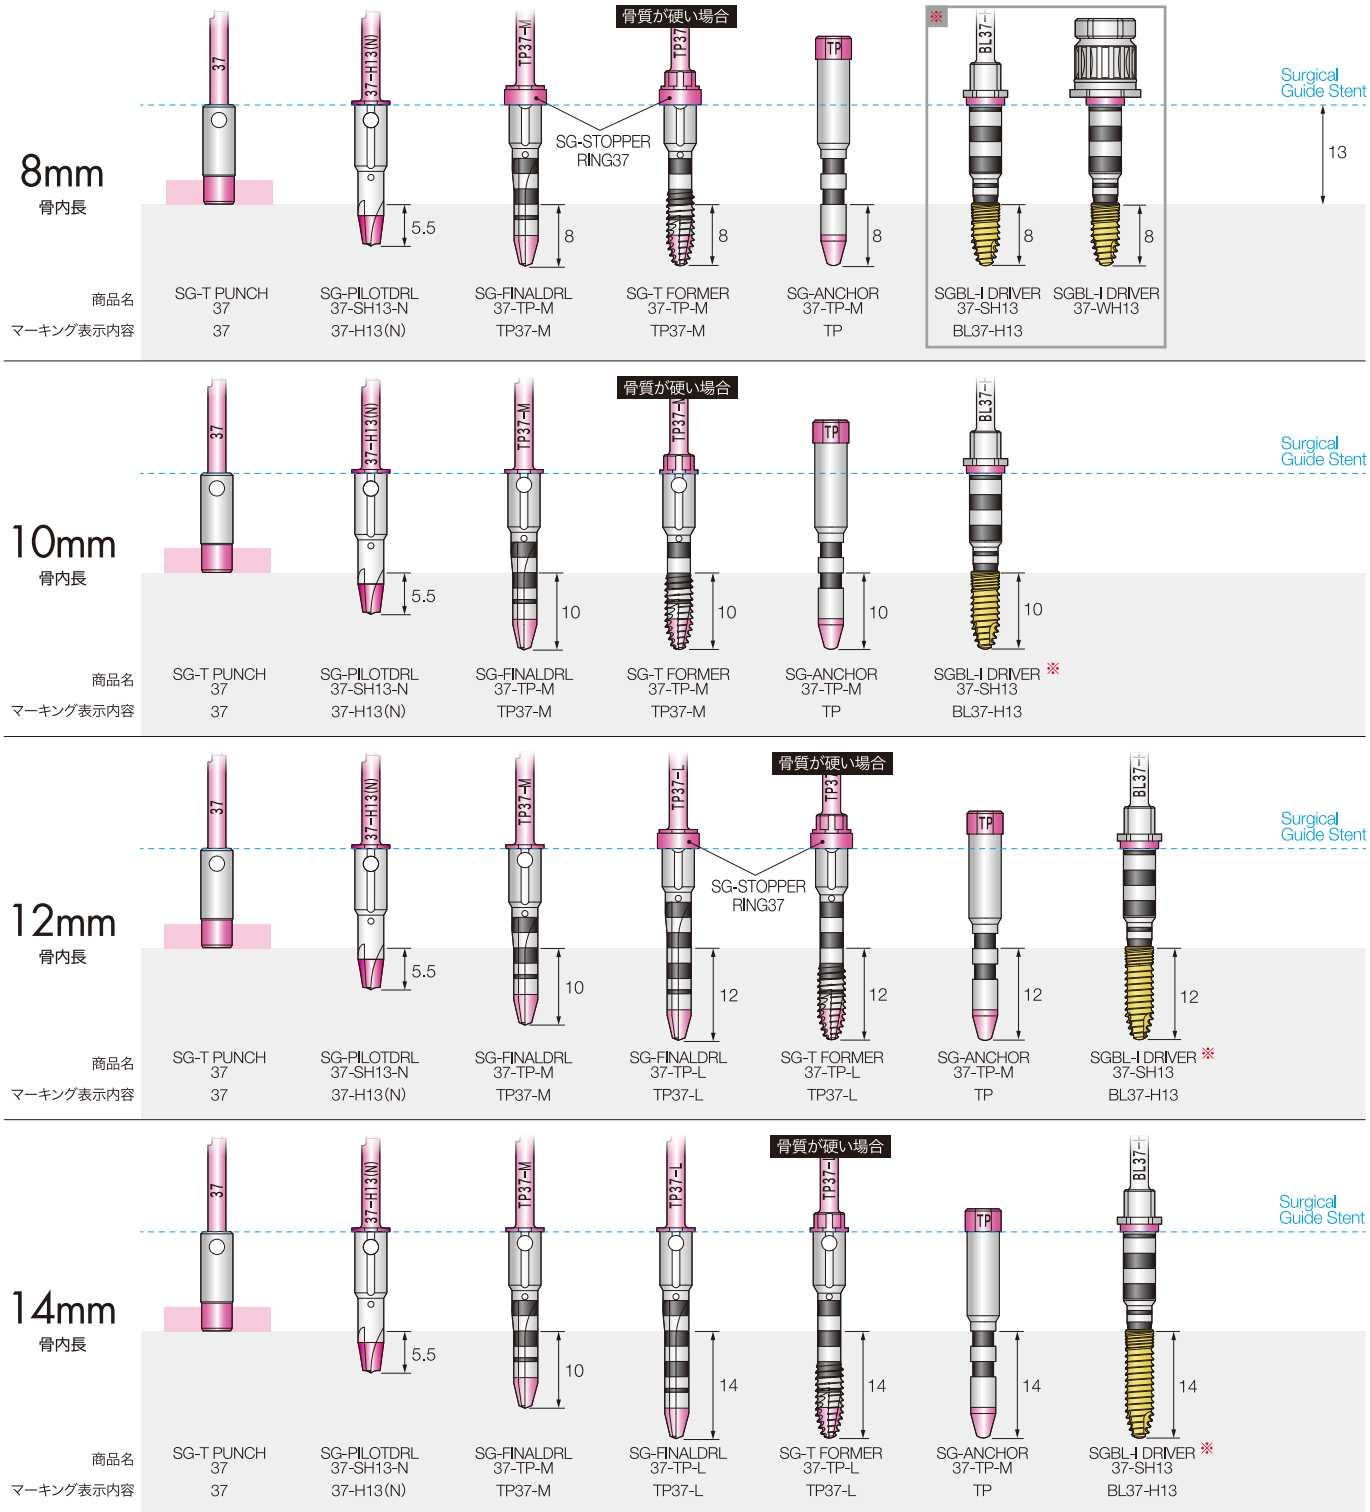

	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-T FORMER 37-TP-M	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13	SGBL-I DRIVER 37-WH13
商品名	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-T FORMER 37-TP-M	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※	SGBL-I DRIVER 37-WH13
マーキング表示内容	37	37-H13(N)	TP37-M	TP37-M	TP	BL37-H13	

	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-T FORMER 37-TP-M	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※
商品名	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-T FORMER 37-TP-M	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※
マーキング表示内容	37	37-H13(N)	TP37-M	TP37-M	TP	BL37-H13

	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-FINALDRL 37-TP-L	SG-T FORMER 37-TP-L	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※
商品名	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-FINALDRL 37-TP-L	SG-T FORMER 37-TP-L	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※
マーキング表示内容	37	37-H13(N)	TP37-M	TP37-L	TP37-L	TP	BL37-H13

	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-FINALDRL 37-TP-L	SG-T FORMER 37-TP-L	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※
商品名	SG-T PUNCH 37	SG-PILOTDRL 37-SH13-N	SG-FINALDRL 37-TP-M	SG-FINALDRL 37-TP-L	SG-T FORMER 37-TP-L	SG-ANCHOR 37-TP-M	SGBL-I DRIVER 37-SH13 ※
マーキング表示内容	37	37-H13(N)	TP37-M	TP37-L	TP37-L	TP	BL37-H13

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ4.2mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

8mm 骨内長

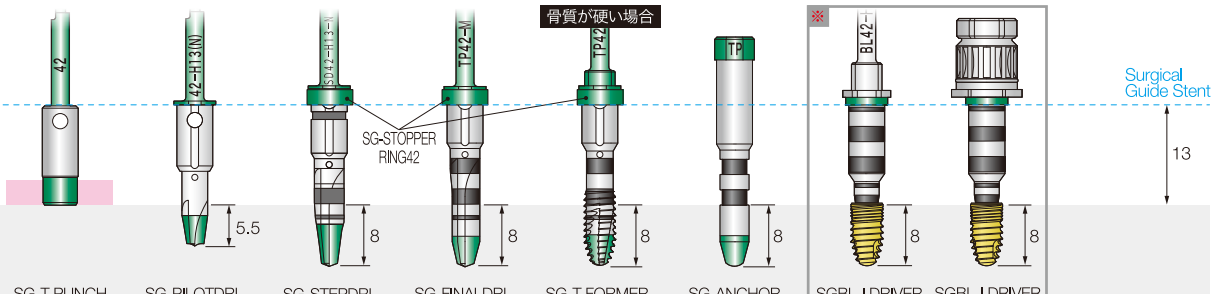

商品名	SG-T PUNCH 42	SG-PILOTDRL 42-SH13-N	SG-STEPDRL 42-SH13-N	SG-FINALDRL 42-TP-M	SG-T FORMER 42-TP-M	SG-ANCHOR 42-TP-M	SGBL-I DRIVER 42-SH13	SGBL-I DRIVER 42-WH13
マーキング表示内容	42	42-H13(N)	SD42-H13-N	TP42-M	TP42-M	TP	BL42-H13	

10mm 骨内長

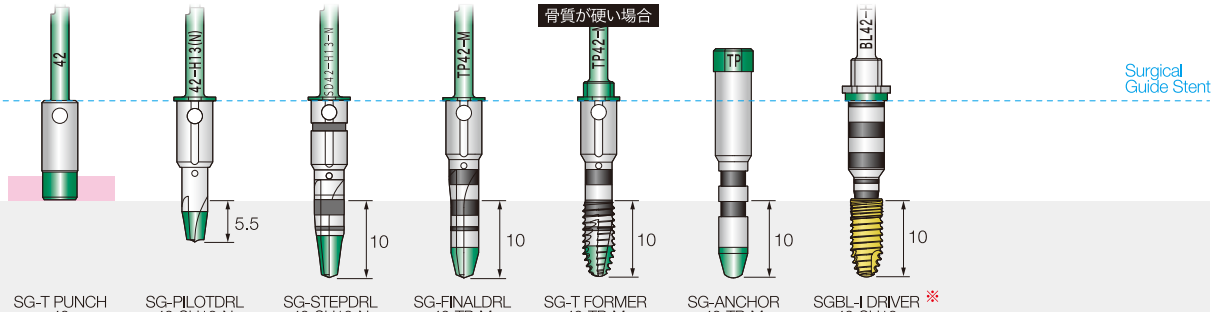

商品名	SG-T PUNCH 42	SG-PILOTDRL 42-SH13-N	SG-STEPDRL 42-SH13-N	SG-FINALDRL 42-TP-M	SG-T FORMER 42-TP-M	SG-ANCHOR 42-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 42-SH13
マーキング表示内容	42	42-H13(N)	SD42-H13-N	TP42-M	TP42-M	TP	BL42-H13

12mm 骨内長

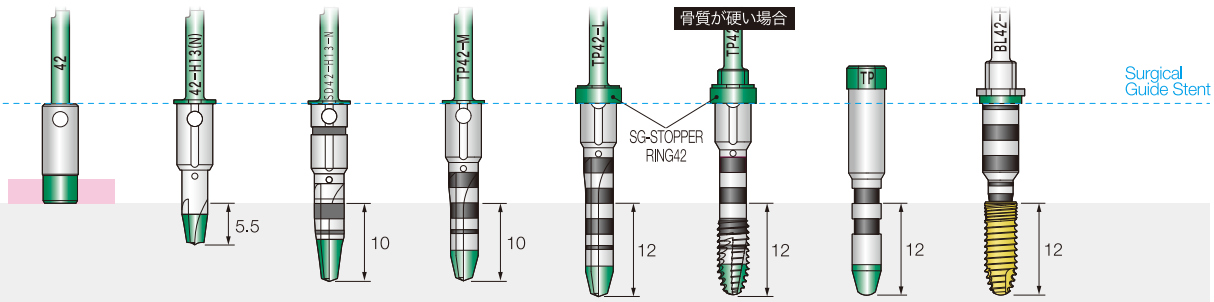

商品名	SG-T PUNCH 42	SG-PILOTDRL 42-SH13-N	SG-STEPDRL 42-SH13-N	SG-FINALDRL 42-TP-M	SG-FINALDRL 42-TP-L	SG-T FORMER 42-TP-L	SG-ANCHOR 42-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 42-SH13
マーキング表示内容	42	42-H13(N)	SD42-H13-N	TP42-M	TP42-L	TP42-L	TP	BL42-H13

14mm 骨内長

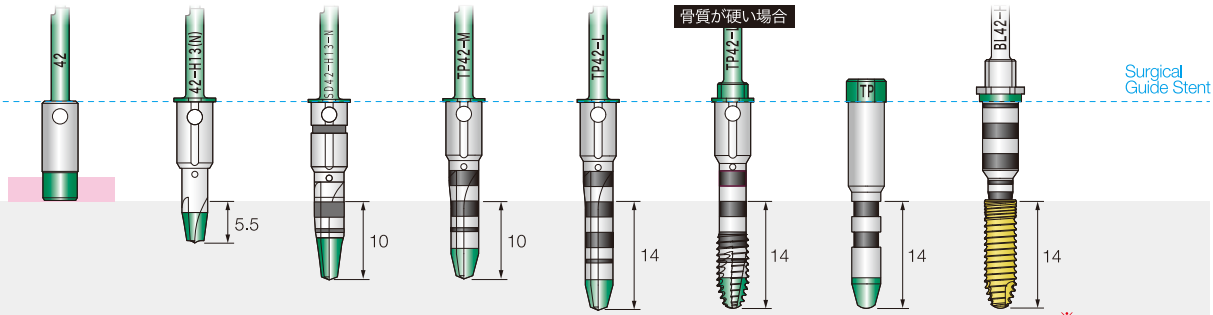

商品名	SG-T PUNCH 42	SG-PILOTDRL 42-SH13-N	SG-STEPDRL 42-SH13-N	SG-FINALDRL 42-TP-M	SG-FINALDRL 42-TP-L	SG-T FORMER 42-TP-L	SG-ANCHOR 42-TP-M	SGBL-I DRIVER ※ 42-SH13
マーキング表示内容	42	42-H13(N)	SD42-H13-N	TP42-M	TP42-L	TP42-L	TP	BL42-H13

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント固定

FINESIA® Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ4.7mm

1P、TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

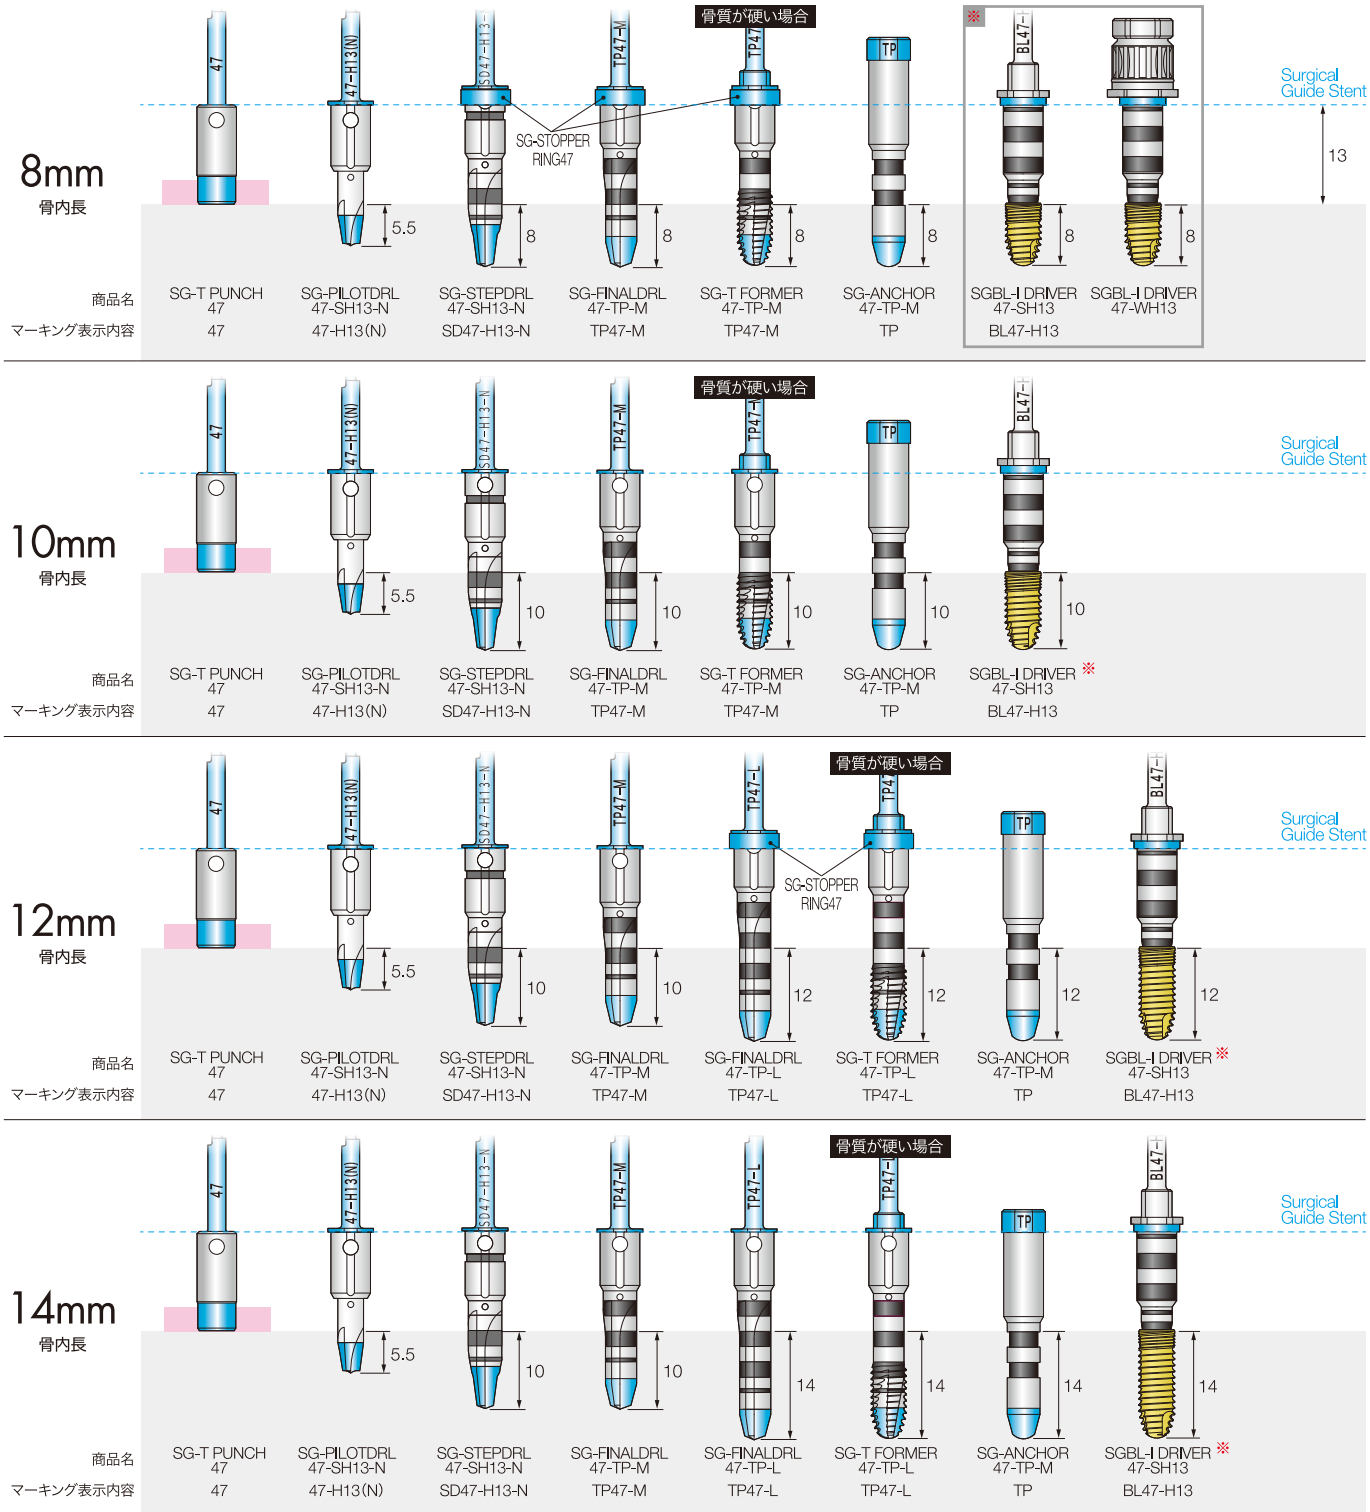

1P：1Piece　TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

13mm
サージカルガイドステント装着

FINESIA Surgical Guide System
術式チャート

Tapered type

インプラント径 φ5.2mm

TLタイプはサージカルガイドステントを外してインプラントを埋入してください。

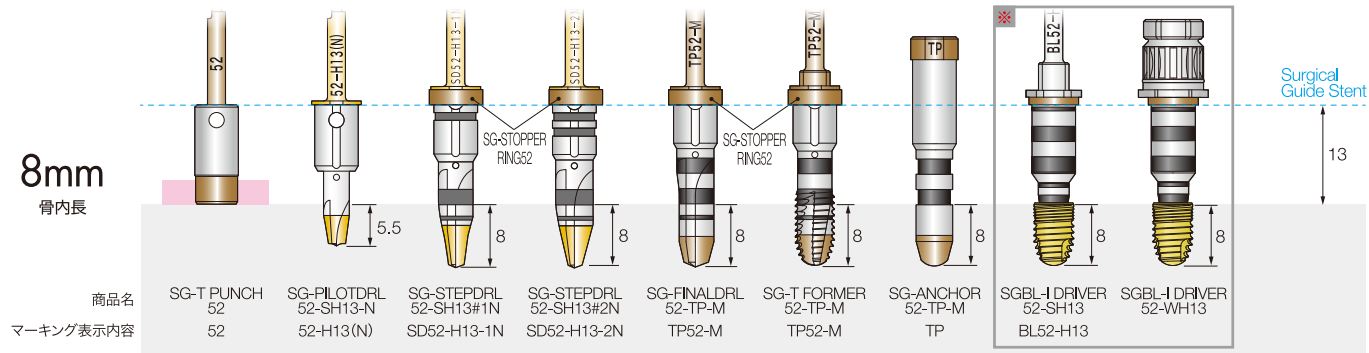

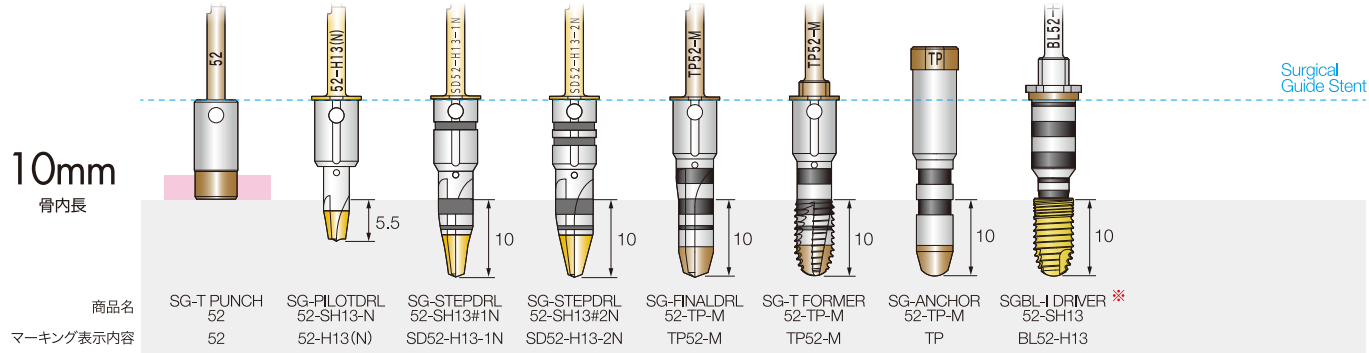

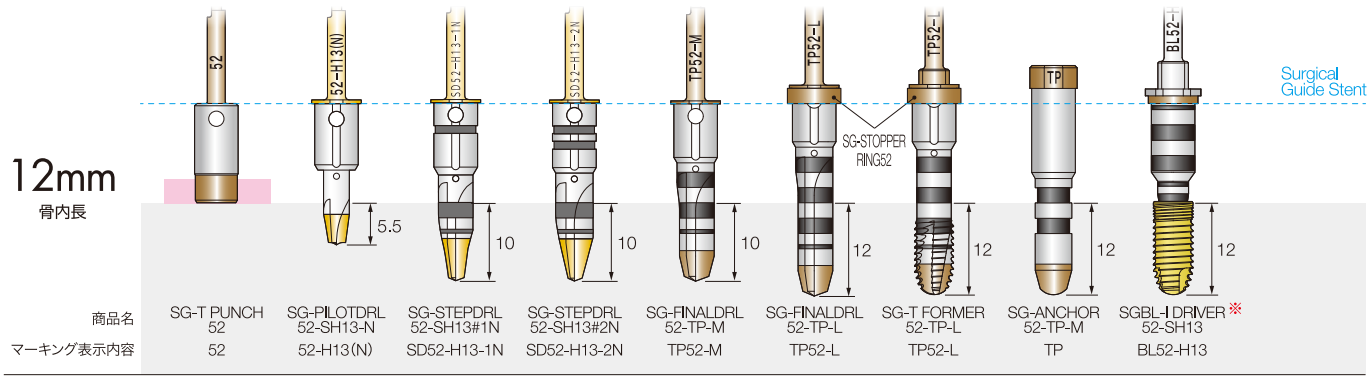

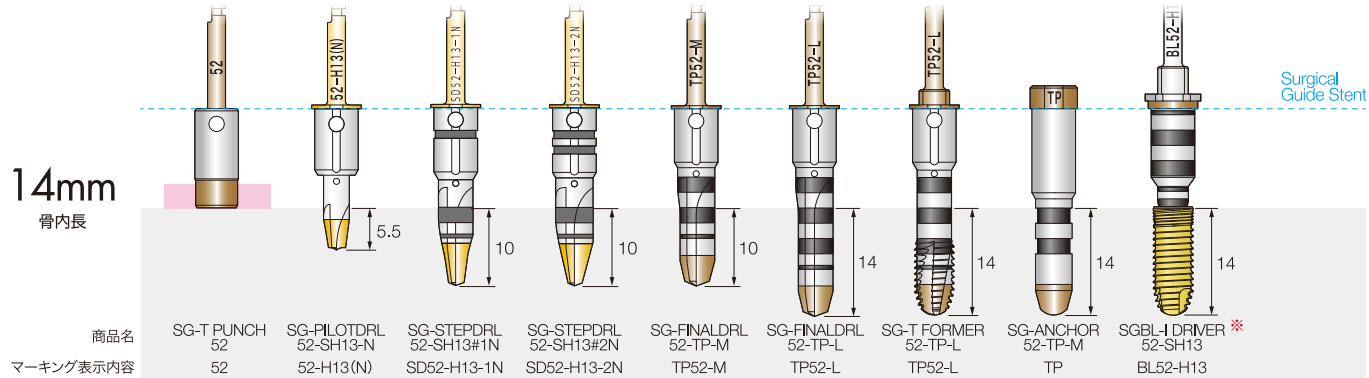

TL：Tissue Level

単位 :mm

※骨内長を問わず、インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

京セラメディカル株式会社

https://www.kyocera-medical.co.jp

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

札 幌 営 業 所 札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

東 京 営 業 所 東京都港区三田3丁目5番19号（住友不動産東京三田ガーデンタワー23F）〒108-0073
Tel:03-6364-5565 Fax:03-6364-5560

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17（KDX桜通ビル8F）〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
（注）デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大 阪 営 業 所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003
Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157

岡 山 営 業 所 岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

九 州 営 業 所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト6F）〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

www.finesia.world

FINESIAサージカルガイドシステム器具【医療機器届出番号：26B1X10019101123】
一般的名称：歯科用インプラント手術器具　一般医療機器（クラスⅠ）

「FINESIA」は、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2025年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。

ⓒ 2025 KYOCERA Medical Corporation

1_011 D-115-7t